

Part no.	312-4289100-XXX
Product name	血糖/單罐(單片包)試片說明書/Diatesse XPER/NL、EN、FR、DE、DA
Spec	L250*W432mm/雜誌紙65P/雙面/黑/5折(短邊對1折+長邊彈簧2折再對2折)完成尺寸L125*W36mm
Color	Tsaiyi
Designer	 K100  K80  K30



TD-4289B Versie 5.0 2023/6  
312-4289100-XXX  
D1091018-001

## Bloedglucose-teststrips

### Voor gebruik met

#### Waarschuwingen

- Voor *in-vitro* diagnostisch gebruik (alleen bestemd voor gebruik buiten het lichaam).
- Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
- Professionele beroepspraktijken in de gezondheidszorg en andere gebruikers die meerdere patiënten testen met dit systeem, moeten alle voorwerpen die in contact zijn gekomen met menselijk bloed uiterst voorzichtig behandelen om overbrenging van infectieziekten te voorkomen, inclusief gesteriliseerde voorwerpen.
- Lees deze blsijsuiter en de handleiding behorend bij uw Diatesse XPER meter voordat u deze teststrips gaat gebruiken. Gebruik alleen Diatesse XPER bloedglucose-teststrips met de Diatesse XPER meter (TD-4289B) om nauwkeurige resultaten te verkrijgen en om aanspraak te kunnen maken op de fabrieksgarantie.
- Resultaten kunnen onnauwkeurig zijn als testen worden uitgevoerd bij patiënten meteen abnormaal lage bloeddruk of bij patiënten die in shock verkeren.
- Bij patiënten met een gestoorde perifere bloedcirculatie wordt aanname van capillaire bloed uit de goedegekeurde monsterafnampelosten niet geadviseerd, omdat de resultaten mogelijk geen betrouwbaar afspiegeling zijn van de fysiologische bloedglucosewaarde. Dit kan voorkomen in de volgende omstandigheden: ernstige dehydratie als gevolg van diabetische ketoacidose of als gevolg van hyperglykemie door stress, hyperosmolair non-ketotische coma, shock, gedecompenseerde hartfalen NYHA-klaasse IV of peripherial arterial occlusive disease (PAOD), chronische belemmering van de bloedstroom naar de benen).
- Teststrips en lancette n dienen altijd uit de buut van kinderen gehouden te worden. Neem bij inslikken onmiddellijk contact op met een arts voor advies.

#### Gebruiksdoel

Met Diatesse XPER bloedglucose-teststrips kunt u samen met de Diatesse XPER meter (TD-4289B) uw bloedglucose-waarden zelf meten, of laten meten door zorgprofessionals. Het systeem gebruikt verste capillaire volbloedmonsters uit de vinger en veneus volbloed. Het systeem is niet bedoeld voor het diagnostiseren en screening van diabetes mellitus. Zorgprofessionals kunnen de teststrips gebruiken om zowel capillaire als veneus volbloed te testen; voor thuisgebruik kan alleen capillaire volbloed getest worden.

#### Beperkingen

- Hematocriet:** De hematocrietwaarde is beperkt tot waarden tussen de 0 - 70 %.
- Metabolites:** Dopamine, L-Dopa, methyldopa, urinezuur, ascorbinezuur en paracetamol bij een normale bloedconcentratie zullen de resultaten van een bloedglucosetest niet significant beïnvloeden.
- Er is geen significantie interferentie bij aanwezigheid van galactose, maltose of fructose geobserveerd in bloedglucosetests.
- Lipemische effecten:** triglyceriden in het bloed tot maximaal 33,9 mmol/L (3,000 mg/dL) beïnvloeden de resultaten niet significant, maar kunnen de resultaten wel beïnvloeden bij hogere waarden.
- Hoogte-effecten:** Hoogten tot maximaal 3.275 meter hebben geen invloed op de testresultaten.
- Gebruik uitsluitend heparine als antistollingsmiddel voor vers capillaire of veneus volbloed.
- Er zijn geen beperkingen/interferenties bij maltose tot aan 1.000 mg/dL en icodextrine tot aan 2.000 mg/dL.

De volgende stoffen kunnen, indien ze hoger zijn dan de limietwaarden, getest worden met de Diatesse XPER meter (TD-4289B), verhoogde glucosewaarden opleveren:

Overzicht van stoffen en concentraties buiten de limieten met interferentie:


Stofnaam	Beperkende concentratie (mg/dL)	Therapeutische/fysiologisch concentratiebereik (of bovenlimiet) mg/dL
Acetaminophen (paracetamol)	> 20	0,45 - 3
Ascorbinezuur	> 5	2
Urinezuur	> 10	2 - 8

#### Opslag en behandeling

**BELANGRIJK:** Gebruik de bloedglucose-teststrips niet na de uiterste gebruiksdatum.

- Schrijf de datum waarop u het huisje met bloedglucose-teststrips voor het eerst geopend heeft op het etiket (alleen bij strips in een huisje).
- Bloedglucose-teststrips niet gebruiken na de uiterste vervaldatum.**
- Bewaar de bloedglucose-teststrips op een koele, droge plaats bij een temperatuur tussen de 2 °C en 30 °C (35,6 °F en 86 °F) en bij een relatieve vochtigheid tussen 10 % en 90 %.
- Houd de bloedglucose-teststrips uit de buurt van direct zonlicht. Bewaar de bloedglucose-teststrips niet in zeer vochtige omstandigheden.
- Bewaar de bloedglucose-teststrips in het originele huisje/foliepack. Plaats de bloedglucose-teststrips niet in een ander huisje. Bij bloedglucose-teststrips in foliepack: laat de (nog) niet gebruikte foliepacks gesloten.
- Vermijd het aanraken van de bloedglucose-teststrips met naakte handen.
- Gebruik de bloedglucose-teststrip onmiddellijk nadat u deze uit het huisje/foliepack heeft gehaald. Het huisje dient u onmiddellijk, nadat u een bloedglucose-teststrip heeft gepakt, weer te sluiten.
- Houd het huisje/oliepack, behalve om een bloedglucose-teststrip te pakken, altijd gesloten.
- Buij, knip of verander de bloedglucose-teststrip niet.


#### Uiterlijk van de bloedglucose-teststrips

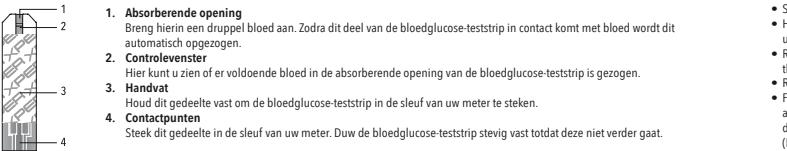


**ATTENTIE**  
De voorzijde van de bloedglucose-teststrip moet omhooggericht zijn wanneer u de teststrip in de meter inbrengt. Uw testresultaten kunnen afwijken als het gedeelte met de contactpunten niet volledig en correct in de sleuf van de meter is.

#### Uw bloedglucose testen


Was uw handen en droog deze af voordat u begint.



**Stap 1**  
Duij de bloedglucose-teststrip (het gedeelte met de contactpunten) volledig in de sleuf van de meter totdat deze niet verder gaat. Wanneer de bloedglucose-teststrip correct is ingebracht, voert de meter een aantal zelftests uit.



**Stap 2**  
Neem een bloedmonster van 0,5 µL af met de bloedglucose-teststrip. Er is een voldoende hoeveelheid bloed nodig voor een nauwkeurig testresultaat. Raak de bloeddruppel met de absorberende opening van de bloedglucose-teststrip aan en wacht tot het controlevenster volledig gevuld is. Breng GEEN uitgesmeerde bloedmonster aan. Als er voldoende bloed in het testvenster zit begint de meter automatisch af te tellen.



**Stap 3**  
Na enkele seconden geeft de meter uw bloedglucosewaarde aan. Uw laatste meting wordt automatisch opgeslagen in de meter. Schakel uw meter uit door de teststrip te verwijderen. Gooi de gebruikte bloedglucose-teststrip weg.

Zie voor meer informatie de handleiding van de meter.

De door u gebruikte lancet en bloedglucose-teststrip kunnen een potentieel biologisch gevaar vormen. Gooi deze items zorgvuldig weg volgens de plaatselijke voorschriften.

#### Uw uitslag aflezen

Uw bloedglucosetests geven **plasma-equivalente waarden** en worden weergegeven in millimol glucose per liter bloed (mmol/L). Het meetbereik van de meter is 0,56 - 44,4 mmol/L (10 - 800 mg/dL).

#### Referentiewaarden

Tijdstip van de dag	Normal plasma glucosebereik bij mensen zonder diabetes
Nuchter en voor de maaltijd	< 5,6 mmol/L (100 mg/dL)
2 uur na maaltijden	< 7,8 mmol/L (140 mg/dL)

Bron: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes - 2018 Jan; 41(Supplement 1): S1-S2.

Raadpleeg uw arts om het doelbereik vast te stellen dat u het best werkt.

#### Twijfelfachting of inconsistentie resultaten

- Als uw testresultaten ongewoon zijn of niet kloppen met hoe u zich voelt:
- Zorg dat het controlevenster van de bloedglucose-teststrip volledig gevuld is met bloed.
- Controleer de uiterste gebruiksdatum van de bloedglucose-teststrips.
- Controleer de werking van uw meter en bloedglucose-teststrip met de controlesoluut.

**LET OP:** Ongewoon hoge of lage bloedglucosewaarden kunnen symptomen zijn van een ernstige medische aandoening. Als de meeste van uw resultaten ongewoon hoog of laag zijn, neemt u dan contact op met uw zorgprofessional.

#### Kwaliteitscontroletests

De controlesoluut bevat een vaste hoeveelheid glucose die reageert met bloedglucose-teststrips. U kunt de werking van uw meter, de bloedglucose-teststrip en de uiterste gebruiksdatum testen door de resultaten van de controlesoluut te vergelijken met het bereik dat op het etiket van het huisje/oliepack met bloedglucose-teststrips staat aangeduid. Lees de handleiding van de meter voor volledige testimsturen.

**BELANGRIJK:** Het referentierbereik van controlesoluut kan variëren bij elk nieuw huisje/oliepack en elk nieuw huisje/oliepack met bloedglucose-teststrips. Controleer daarom altijd het bereik op het etiket van uw huidige huisje/oliepack met bloedglucose-teststrips.

#### Chemische bestanddelen

Glucosedehydronase (*E. coli*) 8 %

Enzyme-protector 8 %

Elektron-shuttle 55 %

Niet-reactieve ingrediënten 29 %

#### Anvullende informatie voor zorgprofessionals

Draag altijd handschoenen en volg de infectiepreventieprocedures van uw instelling wanneer u testen met bloedmonsters van patiënten uitvoert. Gebruik alleen verste volbloedmonsters. Zorgprofessionals kunnen bloedglucose-teststrips gebruiken voor het testen van capillaire en veneus volbloed.

Monstergrootte: 0,5 µL

Reactietijd: 5 seconden

Meetaccuracy: 0,56 - 44,4 mmol/L (10 - 800 mg/dL)

Hematocrietbereik: 0 - 70 %

Höhenefekte: Hohen bis zu 3.275 Meter haben keinen Einfluss auf die Testergebnisse.

Verwenden Sie Heparin nur als Antikoagulant für frisches kapilläres und venöses Vollblut.

Es gibt keine Einschränkungen / Interferenzen mit Maltose bis zu 1,000 mg/dL und Icodextrine bis zu 2,000 mg/dL.

Die folgenden Substanzen können, wenn sie die Grenzwerte überschreiten, mit dem Diatesse XPER-Messgerät (TD-4289B) getestet werden, erhöhte Glukosewerte erzeugen:

Übersicht über Stoffe und Konzentrationen außerhalb der Interferenzgrenzen:


Stoffname	Grenzwert der Konzentration (mg/dL)	Therapeutischer / physiologischer Konzentrationsbereich (oder Obergrenze) mg/dL
Acetaminophen (Paracetamol)	> 20	0,45 - 3
Ascorbinsäure	> 5	2
Harnsäure	> 10	2 - 8

#### Lagering en Handhabung

**WICHTIG:** Verwenden Sie die Blutzuckerteststreifen nicht nach dem Verfallsdatum.

- Schreiben Sie das Datum, an dem Sie das Röhrchen mit Blutzuckerteststreifen zum ersten Mal geöffnet haben, auf das Etikett (nur für Streifen in einem Röhrchen). Verwenden Sie die Blutzuckerteststreifen nach dem Verfallsdatum nicht mehr.
- Lagern Sie die Blutzuckerteststreifen an einem kühlen, trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 30 °C (35,6 °F und 86 °F) und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 90 %.
- Halten Sie die Blutzuckerteststreifen vor direkter Sonneninstrahlung fern. Lagern Sie die Blutzuckerteststreifen nicht unter sehr feuchten Bedingungen.
- Bewahren Sie die Blutzuckerteststreifen **nur** in der Originalverpackung auf. Legen Sie die Blutzuckerteststreifen nicht in ein anderes Röhrchen. Für Blutzuckerteststreifen in Folienverpackungen: (noch) nicht verwendete Folienverpackungen geschlossen lassen.
- Berühren Sie die Blutzuckerteststreifen nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie den Blutzuckerteststreifen sofort nach Entfernen aus der Röhrchen-/ Folienverpackung. Sie müssen das Röhrchen sofort nach der Entnahme eines Blutzuckerteststreifens schließen.
- Halten Sie das Röhrchen / die Folienverpackung immer geschlossen, außer um Zugang zu einem Blutzuckerteststreifen zu erhalten.
- Bielen, schneiden oder modifizieren Sie den Blutzuckerteststreifen nicht.

#### Außere Merkmale eines Blutzuckerteststreifens

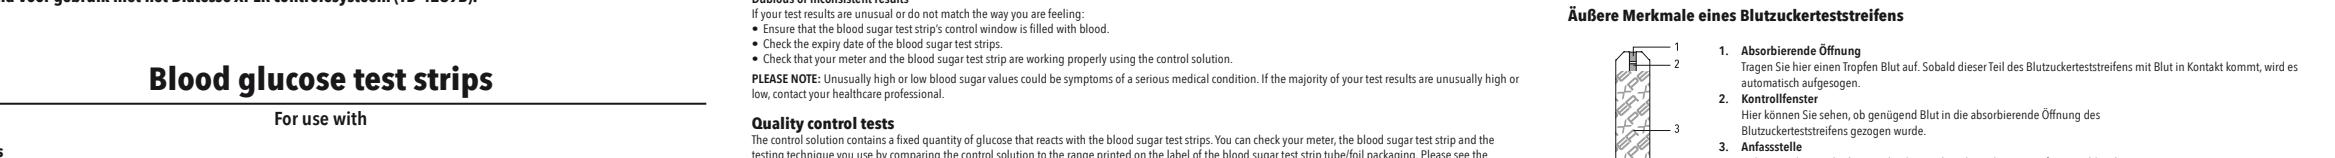

#### Reading your results

Your blood sugar measurements are **plasma equivalent values** and are shown in millimoles of glucose per litre of blood (mmol/L). The measuring range of the meter is from 0,56 to 44 mmol/L (10 - 800 mg/dL).

#### Referentie values

Time of day	Normal plasma glucose range for nondiabetics
Before meals on an empty stomach	< 5,6 mmol/L (100 mg/dL)
2 hours after meals	< 7,8 mmol/L (140 mg/dL)

Source: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes - 2018 Jan; 41 (Supplement 1): S1-S2.

Consult your doctor in order to determine the target range that suits you best.

#### Intended Use

Thanks to the Diatesse XPER blood glucose test strips, you can use the Diatesse XPER meter (TD-4289B) to measure your blood glucose levels or have them checked by healthcare professionals. The system uses fresh capillary whole blood samples extracted from a finger and venous whole blood. The system is not designed to diagnose and screen for diabetes mellitus. Healthcare professionals can use the test strips to test both capillary and venous whole blood; only capillary whole blood samples can be tested at home.

#### Accuracy

Diabetes experts have suggested that blood sugar meters must be within ± 0,83 mmol/L (± 15 mg/dL) of the reference method when the glucose concentration is less than 5,5 mmol/L (100 mg/dL) and within ± 15 % of the reference method when the glucose concentration is 5,55 mmol/L (100 mg/dL) or higher.

#### Restrictions

- Hematocrit:** The H

Konsultieren Sie Ihren Arzt, um den für Sie am besten geeigneten Zielbereich zu bestimmen.

#### Fragwürdige oder inkonsistente Ergebnisse

- Wenn Ihre Testergebnisse ungewöhnlich sind oder nicht mit Ihrem Gefühl übereinstimmen:
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollfenster des Blutzuckererteststreifens vollständig mit Blut gefüllt ist.
- Überprüfen Sie die Verfallsdatum der Blutzuckererteststreifen.
- Überprüfen Sie die Leistung Ihres Messgeräts und des Blutzuckererteststreifens mit der Kontrolllösung.

**VORSICHT:** Ungewöhnlich hohe oder niedrig Blutzuckerspiegel können Symptome einer schwerwiegenden Erkrankung sein. Wenn die meisten Ihrer Ergebnisse ungewöhnlich hoch oder niedrig sind, wenden Sie sich bitte an Ihren medizinischen Betreuer.

#### Qualitätskontrolltests

Die Kontrolllösung enthält eine feste Menge Glukose, die mit Blutzuckererteststreifen reagiert. Sie können die Leistung Ihres Messgeräts, des Blutzuckererteststreifens und der verwendeten Technik testen, indem Sie die Ergebnisse der Kontrolllösung mit dem auf dem Etikett des Röhrchens / Folienpackung mit Blutzuckererteststreifen angegebenen Bereich vergleichen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Messgeräts, um vollständige Testanweisungen zu erhalten.

**WICHTIG:** Der Referenzbereich der Kontrolllösung kann mit jedem neuen Kontrolllösungsflaschen und jedem neuen Röhrchen / jeder neuen Folienpackung mit Blutzuckererteststreifen variieren. Überprüfen Sie daher immer den Bereich auf dem Etikett Ihres aktuellen Röhrchens / Ihrer Folienpackung mit Blutzuckererteststreifen.

#### Chemische Bestandteile

Glucosidhydrogenase (*E. coli*) 8 %

Enzymschutz 8 %

Elektronenshuttle 55 %

Nicht reaktive Inhaltsstoffe 29 %

#### Zusätzliche Informationen für medizinisches Fachpersonal

Tragen Sie immer Handschuhe und folgen Sie die Verfahren zur Infektionsprävention Ihrer Einrichtung, wenn Sie Tests mit Blutproben von Patienten durchführen. Verwenden Sie nur frische Vollblutproben. Medizinisches Fachpersonal kann Blutzuckererteststreifen verwenden, um kapillares und venöses Vollblut zu testen.

Probengröße: 0,5 µL Reaktionzeit: 5 Sekunden

Messbereichsskala: 0,56 - 44 mmol/L (10 - 800 mg/dL) Hämatokritbereich: 0 - 70 %

**Genaugigkeit**

Diabetes-Experten haben vorgeschlagen, dass Glukosemessgeräte bei  $\pm 0,83 \text{ mmol/L} (\pm 15 \text{ mg/dL})$  der Referenzmethode liegen sollten, wenn die Glukosekonzentration unter  $5,55 \text{ mmol/L}$  ( $100 \text{ mg/dL}$ ) liegt, und bei  $\pm 15 \%$  der Referenzmethode, wenn die Glukosekonzentration  $5,55 \text{ mmol/L}$  ( $100 \text{ mg/dL}$ ) oder höher liegt.

Reagens-system LOT	Innerhalb $\pm 0,28 \text{ mmol/L}$	Innerhalb $\pm 0,56 \text{ mmol/L}$	Innerhalb $\pm 0,83 \text{ mmol/L}$
TD16J115-CEE	44 / 58 (75,9 %)	56 / 58 (96,6 %)	58 / 58 (100 %)
TD16K122-CEE	45 / 58 (77,6 %)	58 / 58 (100 %)	58 / 58 (100 %)
TD16L112-CEE	40 / 58 (69,0 %)	58 / 58 (100 %)	58 / 58 (100 %)

For a glucose concentration of  $< 5,6 \text{ mmol/L}$ , 100% of the measured results were within  $\pm 0,83 \text{ mmol/L}$ .

On average,  $98,9 \%$  were within  $\pm 0,6 \text{ mmol/L}$ .

Reagens-system LOT	Innerhalb $\pm 5 \%$	Innerhalb $\pm 10 \%$	Innerhalb $\pm 15 \%$
TD16J115-CEE	100 / 142 (70,4 %)	133 / 142 (93,7 %)	140 / 142 (98,6 %)
TD16K122-CEE	102 / 142 (71,8 %)	138 / 142 (97,2 %)	142 / 142 (100 %)
TD16L112-CEE	100 / 142 (70,4 %)	139 / 142 (97,9 %)	142 / 142 (100 %)

Bei einer Glukosekonzentration von  $\pm 5,6 \text{ mmol/L}$  lagen durchschnittlich  $96,2 \%$  der gemessenen Ergebnisse bei  $\pm 10 \%$ .

**Hinweis:** Wählen die Ergebnisse der Diatesse XPER Blutzuckererteststreifen mit den Referenzwerten verglichen werden, werden Differenzwerte unter  $5,55 \text{ mmol/L}$  ( $100 \text{ mg/dL}$ ) in mmol/L ausgedrückt und Differenzwerte über  $5,55 \text{ mmol/L}$  ( $100 \text{ mg/dL}$ ) werden als Prozentsatz ausgedrückt.

**Genaugigkeit**

Der CV (%) beträgt weniger als 5 %, sowohl bei der mittleren als auch bei der Wiederholbarkeitsgenauigkeit.

#### Ausschließlich zu verwenden in Kombination mit dem Diatesse XPER Blutzuckerkontrollsysteem (TD-4289B).

## Bandlettes réactives pour mesure de la glycémie

### Pour utilisation avec

#### Précautions

- Bandlettes conçues pour les mesures *in vitro* (uniquement à l'extérieur de l'organisme).
- À usage unique seulement.
- Tous les professionnels de santé et les autres utilisateurs qui testent plusieurs patients avec ce dispositif doivent traiter tous les objets qui ont été en contact avec du sang humain avec un soin extrême afin de prévenir la transmission de maladies infectieuses, y compris les objets stérilisés.
- Lisez ce mode d'emploi et le manuel fourni avec votre lecteur Diatesse XPER avant d'utiliser ces bandlettes. Utilisez uniquement les bandlettes réactives Diatesse XPER avec le lecteur Diatesse XPER (TD-4289B) pour obtenir des résultats précis et pour faire éventuellement appel à la garantie.
- Tous les résultats peuvent être inexacts si les mesures sont effectuées chez des patients présentant une pression artérielle anormalement basse ou en état de choc.
- Chez les patients dont la circulation sanguine périphérique est perturbée, il n'est pas recommandé de prélever du sang capillaire dans les sites de prélèvement approuvés, car les résultats peuvent ne pas refléter de manière fiable les taux de glycémie physiologiques. Cela peut se produire dans les conditions suivantes : une déshydratation sévère due à une acidocétose diabétique ou à une hyperglycémie non cétoneuse, un état de choc, une insuffisance cardiaque décompensée de classe IV selon la classification du New York Heart Association (NYHA), ou une maladie artérielle obstrutive périphérique (MAOP), obstruction chronique du flux sanguin dans les jambes).
- Tous les bandlettes et les lancettes doivent toujours être tenues hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin pour obtenir une assistance.

#### Usage prévu

Tous les bandlettes DiatesseXPER accompagnant le lecteur Diatesse XPER (TD-4289B) vous permettent de surveiller vous-même votre glycémie ou de la faire mesurer par des professionnels de la santé. Ce système utilise des échantillons de sang complet capillaire frais provenant du doigt et du sang complet veineux. Le système n'est pas destiné au diagnostic et au dépistage du diabète de type 2. Tous les professionnels de santé peuvent utiliser ces bandlettes réactives pour tester à la fois le sang total capillaire et veineux ; pour l'utilisation à domicile, seul le sang complet capillaire peut être testé.

#### Limitations

- Hématocrite : la valeur de l'hématocrite doit être comprise entre 0 et 70 %.
- Métabolites : la dopamine, la L-Dopa, la méthyldopa, l'acide urique, l'acide ascorbique et le paracétamol à une concentration sanguine normale n'affecteront pas de manière significative les résultats d'un test de glycémie.
- Aucune interférence significative en présence de galactose, de maltose ou de fructose n'a été observée dans les tests de glycémie.
- Lipides sanguins : les triglycérides sanguins jusqu'à  $33,9 \text{ mmol/L}$  ( $3.000 \text{ mg/dL}$ ) n'affectent pas de manière significative les résultats, mais peuvent les affecter à des valeurs plus élevées.
- Altitude : jusqu'à 3 275 mètres max, l'altitude n'affecte pas les résultats des tests.
- N'utilisez l'héparine que comme anticoagulant pour le sang total capillaire ou veineux frais.
- On n'observe aucune restriction/interférence pour le maltose jusqu'à  $1.000 \text{ mg/dL}$  et l'icodextrose jusqu'à  $2.000 \text{ mg/dL}$ .

Tous les substances du tableau ci-dessous sont supérieures aux valeurs limites, elles peuvent être testées avec le lecteur Diatesse XPER (TD-4289B), mais entraînent des variations de glycémie élévées.

Substances et concentrations en dehors des limites avec interférence :

Nom de la substance	Concentration limite (mg/dL)	Plage de concentration thérapeutique/physiologique (ou limite supérieure) mg/dL
Acétaminophène (paracétamol)	> 20	0,45 - 3
Acide ascorbique	> 5	2
Acide urique	> 10	2 - 8

#### Conservation et manipulation

**IMPORTANT:** Ne pas utiliser les bandlettes réactives de glycémie après la date d'expiration.

Inscrivez sur l'étiquette la date à laquelle vous avez ouvert le tube de bandlettes réactives pour la première fois (uniquement pour les bandlettes en tube). Ne pas utiliser les bandlettes réactives après la date d'expiration.

Conservez les bandlettes réactives dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre  $2^\circ\text{C}$  et  $30^\circ\text{C}$  ( $35,6^\circ\text{F}$  et  $86^\circ\text{F}$ ) et à une humidité relative comprise entre 10 % et 90 %.

Conservez les bandlettes réactives de glycémie à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne conservez pas les bandlettes réactives dans un endroit très humide.


Conservez les bandlettes réactives dans leur emballage d'origine. Ne placez pas les bandlettes réactives dans un autre tube. Dans le cas des bandlettes réactives conservées dans des emballages en aluminium : laissez fermés les emballages en aluminium (encore) inutilisés.

Évitez de toucher les bandlettes de test glycémique avec les mains humides.

Utilisez la bandelette réactive immédiatement après l'avoir retirée du tube ou de l'emballage en aluminium. Refermez le tube immédiatement après avoir pris la bandelette réactive.

- Gardez toujours le tube ou l'emballage fermé, sauf pour retirer une bandelette réactive.
- Ne pliez pas, ne coupez pas ou ne modifiez pas la bandelette réactive.

#### Schéma de la bandelette réactive




- Ouvrette d'absorption Appliquez votre goutte de sang ici. Dès que cette partie de la bandelette réactive entre en contact avec le sang, celui-ci est吸収される。
- Fenêtre de contrôle Vous pouvez voir ici si une quantité suffisante de sang a été aspirée dans l'ouverture d'absorption de la bandelette.
- Support Tenez cette partie de la bandelette réactive pour l'insérer dans le lecteur.
- Contacts Insérez cette partie dans le lecteur. Poussez fermement la bandelette réactive jusqu'au fond de la fente.



**ATTENTION**  
La face avant de la bandelette réactive doit être orientée vers le haut lorsque vous l'insérez dans le lecteur. Les résultats de votre test peuvent varier si la zone de contact n'est pas entièrement et correctement insérée dans la fente du lecteur.

#### Mesure de votre glycémie

Lavez-vous et séchez-vous les mains avant de commencer.



- Étape 1**  
Insérez la bandelette réactive à fond dans le lecteur (partie contacts). Lorsque la bandelette réactive est correctement insérée, le lecteur effectue un certain nombre de contrôles automatiques.



- Étape 2**  
Prenez un échantillon de sang de  $0,5 \mu\text{L}$  avec la bandelette réactive. Une quantité suffisante de sang est nécessaire pour obtenir un résultat précis. Touchez la goutte de sang avec l'ouverture d'absorption de la bandelette réactive et attendez que la fenêtre de contrôle soit complètement remplie. N'appliquez PAS de frotti sanguin. Quand il y a suffisamment de sang dans la fenêtre de contrôle, le lecteur commence automatiquement le compte à rebours.



- Étape 3**  
Après quelques secondes, le lecteur indique votre glycémie. Votre mesure est automatiquement enregistrée dans le lecteur. Retirez la bandelette réactive pour éteindre le lecteur. Jetez la bandelette réactive utilisée.

Pour plus d'informations, consultez le manuel du lecteur.

La lancette et la bandelette réactive que vous utilisez peuvent présenter un risque biologique potentiel. Éliminez ces éléments avec prudence, conformément à la réglementation locale.

#### Lecture des résultats

Vos mesures de glycémie donnent des *valeurs équivalent-plasma* et sont exprimées en millimoles de glucose par litre de sang (mmol/L). La plage de mesure du lecteur est de  $0,56$  à  $44 \text{ mmol/L}$  ( $10$  -  $800 \text{ mg/dL}$ ).

**BERØRT:** Hvis ikke brug det blod glukose prøve strimmel efter det udleb data.

**BEMÆRK:** Det er ikke tilladt at bruge denne Diatesse XPER blod sukker prøve strimmel før det udleb data.

**Præcision**

Det er ingen begrænsninger/interferenser med respekt til maltose op til  $1.000 \text{ mg/dL}$  og icodextrose op til  $2.000 \text{ mg/dL}$ .

Det følge stoffer kan, hvornår de er i overskydende af det værdi grænser, Vend tilbage steget blod glukose værdier hvornår afprøving ved brug af det Diatesse XPER (TD-4289B):

OverSIGT over stoffer og koncentrationer uden for det øverst og nederst interferens grænser:

Navn mig	Begrænsende koncentration (mg/dL)	Terapeutisk/fysiologisk koncentrationsområde (eller øvre grænse) mg/dL</th
----------	-----------------------------------	--