

### Tilsigtet brug

**VACUETTE**<sup>®</sup> QUICKSHIELD Complete PLUS er beregnet til anvendelse sammen med **VACUETTE**<sup>®</sup>-blodprøverør som ét samlet system til brug ved almindelige venepunkturer. Produktet er konstrueret med et sikkerhedsskjold, som kan aktiveres for at dække kanylen øjeblikkeligt efter udførelse af venepunktur for dermed at beskytte mod utilsigtede nålestiksskader. **VACUETTE**<sup>®</sup> VISIO PLUS-kanyler er udviklet til brug ved daglig og rutinemæssig blodtagning, når denne udføres af en kvalificeret læge. Tilbageløbsvinduet, der ses på den gennemsigtige del af kanylens ansats, hjælper brugeren med at se, om venen er blevet punkteret korrekt. Kanylerne er kun til engangsbrug og bør kun bruges af uddannet sundhedspersonale og i overensstemmelse med denne brugsvejledning.

### Produktbeskrivelse

Den sterile **VACUETTE**<sup>®</sup> QUICKSHIELD Complete PLUS består af en enkelt **VACUETTE**<sup>®</sup> QUICKSHIELD-sikkerhedsrørholder med en præmonteret **VACUETTE**<sup>®</sup> VISIO PLUS-prøvetagningskanyle i en blisterpakning. Den sterile plastrørholder til engangsbrug er konstrueret med et sikkerhedsskjold.

### Forholdsregler/forsigtighedsregler

1. Brug ikke **VACUETTE**<sup>®</sup> QUICKSHIELD Complete PLUS, hvis den er beskadiget.
2. En **VACUETTE**<sup>®</sup> QUICKSHIELD Complete PLUS, der bliver kontamineret med blod, anses som smittefarlig og bør bortskaffes med det samme.
3. Sæt ikke hættten på kanylen igen.
4. Bøj ikke kanylen.
5. Efter udførelse af venepunktur skal den brugte kanyle med **VACUETTE**<sup>®</sup> QUICKSHIELD -sikkerhedsrørholderen bortskaffes som en samlet enhed i en egnet beholder til skarpe genstande i overensstemmelse med laboratoriets gældende politikker og procedurer.
6. Hold altid hænderne bag kanylen under brug og bortskaffelse.
7. Alle biologiske prøver og skarpe genstande, der har været brugt til blodprøvetagning, skal håndteres i henhold til laboratoriets gældende politikker og procedurer.
8. Søg relevant lægehjælp i tilfælde af eksponering for biologiske prøver (f.eks. i tilfælde af stikskader), da der er risiko for, at sådanne prøver kan overføre HIV, viral hepatitis eller andre infektionssygdomme.
9. Bortskaf alle skarpe genstande, der har været brugt til blodprøvetagning, i beholdere til biologisk farligt affald, der er godkendt til dette formål.
10. Der skal altid bæres handsker under udførelse af venepunktur for derved at nedsætte eksponeringsrisikoen.

### Opbevaring

Opbevar rør ved 4 - 36 °C (40 - 97°F).

**BEMÆRK:** Må ikke udsættes for direkte sollys. Overskridelse af den anbefalede opbevaringstemperatur kan medføre, at holderen beskadiges.

### Håndtering

#### LÆS FØLGENDE OPLYSNINGER, FØR VENEPUNKTUR FORETAGES.

FØR AT MINDSKE RISIKOEN FOR KONTAKT MED BLODET SKAL DER BÆRES HANDSKER UNDER VENEPUNKTUR OG ARBEJDE MED BLODPRØVERØR!


1. Åbn blisterpakningen, og tag produktet helt ud af emballagen.

**BEMÆRK:** Blisterpakningen indikerer at produktet er sterilt og i hel stand. Hvis blisterpakningen er brudt eller beskadiget, skal **VACUETTE**<sup>®</sup> QUICKSHIELD Complete PLUS bortskaffes og en ny tages i brug.

**BEMÆRK:** Bøj ikke kanylen, og brug ikke **VACUETTE**<sup>®</sup> QUICKSHIELD Complete PLUS-sikkerhedsrørholderen, hvis kanylen er bøjet.

Prikken på kanylehætten angiver placeringen af den affasede kant.

2. Skjoldet kan drejes til den foretrukne position på holderen, hvor det bliver siddende under venepunkturen.
3. Vælg et punktsted. Anlæg stase (maks. 1 min.), og desinficer venepunkturstedet. Venepunkturstedet må ikke palperes efter desinfektion!
4. Anbring patientens arm, så den peger skråt nedad. Fjern kanylehætten. Udfør venepunkturen, mens patientens arm peger nedad og proppen på røret vender opad.
5. Tryk røret ind i **VACUETTE**<sup>®</sup> QUICKSHIELD Complete PLUS-sikkerhedsrørholderen, indtil kanylen trænger igennem proppens gummimembran. Sørg for at centrere røret i **VACUETTE**<sup>®</sup> QUICKSHIELD Complete PLUS-sikkerhedsrørholderen, når du stikker det igennem gummiproppen, så du undgår at stikke igennem sidevæggen, hvilket vil medføre tab af vakuum.
6. Fjern stasen, så snart der ses blod i røret. Blodprøven må ikke komme i berøring med rørets gummiprop eller kanylespiden under prøvetagningen. Det betyder, at røret under ingen omstændigheder må vendes på hovedet under prøvetagningen. Hold røret på plads ved hjælp af tommelfingeren, indtil det er helt fyldt.



**BEMÆRK:** Der kan i nogle tilfælde løbe blod ud ved kanylens gummibeskyttelse. Træf almindelige sikkerhedsforanstaltninger for at minimere eksponeringsrisikoen.

- Anbring det næste rør i holderen. Sørg for, at blodprøven ikke kommer i berøring med rørets gummiprop eller kanylespidsen under prøvetagningen.
- Så snart blodet stopper med at løbe ind det sidste rør, skal du forsigtigt fjerne kanylen fra venen, idet du trykker mod punkturstedet med en tør, steril vattampon, indtil blødningen stopper. Når blodet koagulerer, kan du evt. sætte et hæfteplaster eller en forbindelse på.


Sæt ikke hæften på kanylen igen! Genmontering af hæften på kanylen øger risikoen for nålestiksskader.

**BEMÆRK:** Efter venepunktur kan der være overskydende blod i rørets prop. Tag de nødvendige forholdsregler under håndtering af rør for at undgå kontakt med dette blod.

#### Aktivering af sikkerhedsskjoldet

Følg nedenstående procedurer umiddelbart efter, at du har fjernet kanylen fra venen, for at aktivere sikkerhedsskjoldet, som beskytter mod nålestiksskader.

- Aktivér sikkerhedsskjoldet ved forsigtigt at trykke skjoldet ind mod nålen på et stabilt underlag. Aktivering kan også ske med tommelfingeren eller en anden finger, men i så fald skal tommelfingeren eller den anden finger altid holdes bag skjoldet. (Se A1/A2)
- Der lyder et klik, når sikkerhedsskjoldet er korrekt og fuldt aktiveret. Risikoen for nålestiksskader er dermed næsten fjernet. (B)
- Kassér den brugte kanyle sammen med **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS** i en egnet beholder til skarpe genstande. (C)

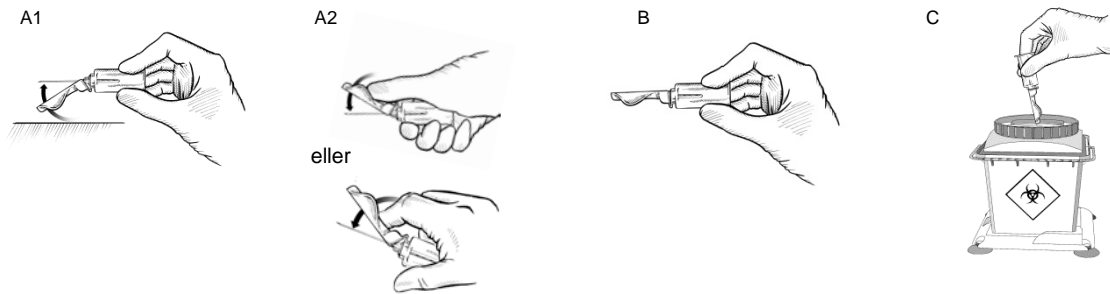

**BEMÆRK:** Undlad at udløse eller genaktivere sikkerhedsmekanismen med magt, efter den er blevet aktiveret.

#### Bortskaffelse

De generelle retningslinjer for hygiejne og lovmæssige bestemmelser vedr. korrekt bortskaffelse af smittefarlige materialer skal respekteres og følges.

Brug af engangshandsker kan reducere infektionsrisikoen.

Forurenede sikkerhedsrørholdere skal bortskaffes umiddelbart efter blodprøvetagningen i dertil egnede affaldsbeholdere til biologisk risikoaffald, som efterfølgende kan autoklaveres og brændes.

#### Oplysninger på etiketten

	Producent		Sterilisation ved bestråling
	Udløbsdato		Må ikke genanvendes
	Batchkode		Læs brugsvejledningen
	Katalognummer		



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Straße 32,  
4550 Kremsmünster  
Austria

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Phone +43 7583 6791