


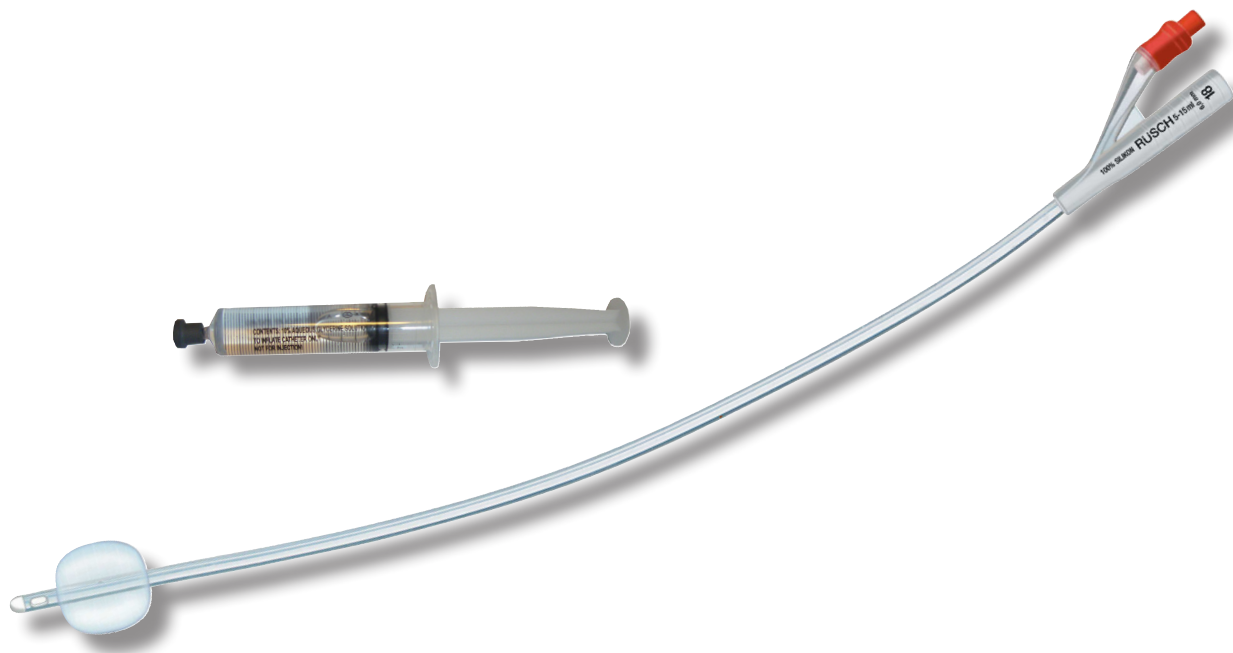

AquaFlate

Silikonkateter med glycerinspruta

Kvarliggande 2-vägs urinkateter, 100 % silikon

Helsilikonkateter med bifogad 10%-ig glycerinlösning, försedd med en röntgenlinje längs skaftet och en röntgentät spets. Katetern finns i manligt kvinnligt och pediatrikt utförande och är avsedd att användas för urinavlastning antingen transuretralt eller suprapubiskt. Vid fyllning med glycerinlösning behöver ballongvolymen ej efterkontrolleras, används sterilt vatten bör ballongvolymen kontrolleras var 3:e vecka.

Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.

Rekommenderad kvarliggandetid 10-12 veckor.

Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO).

Steriltid 5 år

Latex- och PVC fri

Meteko art.nr.	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Längd cm	Förp.
178003-strl	6-10	Nelaton	1,5 - 5	30	5
178004-strl	8-10	Tiemann	3-5	30	5
178000-strl	12-24	Nelaton	10	40	5
178001-strl	12-24	Nelaton	10	20	5
178305-strl	12-24	Tiemann	10	40	5

Produkterna är fria från:

- latex
- parfym
- lanolin
- kolofonium
- silver
- antibiotika
- antimikrobiella tillsatser såsom Triclosan
- bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och föreningar av dessa, mindre än 0,1 %

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se

2015-01