



Airway Management
product catalogue

Edith HMEs



Edith heat and moisture exchangers meet the HME requirements for adult and paediatric patients in operating theater, intensive care unit and other respiratory care environments. The Edith Trach was specially designed to support tracheostomized patients, allowing spontaneously breathing patients to benefit from heat and moisture conservation.

Cat. no.	Description	Qty.
557056200	HME EDITH 500	30/cs
557055200	HME EDITH 1000	30/cs
557057200	HME EDITH 1500	30/cs
557044500	HME EDITH 1500 with flex tube	25/cs
557085000	HME EDITH 1500 Memoflex tube	80/cs
557005000	HME EDITH TRACH	40/cs

Specifications

Caption ID	Cat. No.	Description	Tidal Volumes (mL)	Dead Space (mL)	Weight (g)	Moisture Output (mg H ₂ O/L) Measures at VT (mL)	Moisture Loss (mg H ₂ O/L) Measures at VT (mL)	Pressure Drop (kPa/cmH ₂ O) Measures at VT (mL)	Patient Connection (mm)	Machine Connection (mm)
A.	557056200	Edith 500 HME	70-500	17	6	32 ¹ /30 ¹ 250/500	5.5 ¹ /7.5 ¹ 250/500	0.08/0.8 ¹ (30 L/min) 0.2/2.0 ¹ (60 L/min)	15M/15F	15F
B.	557055200	Edith 1000 HME	110-1000	28	8	30 ¹ /29 ¹ 750/1000	7.5 ¹ /8.5 ¹ 750/1000	0.01/1.0 ¹ (30 L/min) 0.25/2.5 ¹ (60 L/min)	15M/15F	15F
C.	557057200	Edith 1500 HME	150-1500	38	9	31.5 ¹ /30.5 ¹ 750/1000	6.0 ¹ /7.0 ¹ 750/1000	0.01/1.0 ¹ (30 L/min) 0.25/2.5 ¹ (60 L/min)	15M/15F	15F
D.	557044500	Edith 1500 Flex	150-1500	90	20	33.5 ¹ /32.5 ¹ 750/1000	4.0 ¹ /5.0 ¹ 750/1000	0.05/1.5 ¹ (30 L/min) 0.14/1.4 ¹ (60 L/min)	15F	22F
E.	557085000	Edith 1500 Memoflex	150-1500	90	20	33.5 ¹ /32.5 ¹ 750/1000	4.0 ¹ /5.0 ¹ 750/1000	0.05/1.5 ¹ (30 L/min) 0.14/1.4 ¹ (60 L/min)	15F	22F
F.	557005000	Edith Trach	60-1000	16	6	24 ² 500	13.5 ² 500	0.02/2.2 ¹ (60 L/min)	15F	n/a

Change frequency: 24 hours

¹ Measured according to standard EN ISO 9360-1:2009

² Moisture loss is determined using dry gas (not room air).



A. 557056200 HME B. 557055200 HME C. 557057200 HME D. 557044500 HME E. 557085000 HME F. 557005000 Trach HME

AirLife HMEF's (formerly Vital Signs)



AirLife HMEF's

AirLife heat and moisture exchangers with filters (HMEFs) meet filtration requirements for adult and paediatric applications in the operating room, intensive care unit and other respiratory care environments.

Caption ID	Cat. No.	Description	Qty.
A.	557070100	HMEF 1000/S with gas sampling port	50
B.	557070500	HMEF 500 with gas sampling port	40
C.	M1004132	HMEF 750/S with gas sampling port	50
D.	M1010534	HMEF 1000/S with gas sampling port and angled connection	50
E.	M1010538	HMEF 750/S with gas sampling port and angled connection	50
F.	M1038637	HMEF 1000	50
G.	M1038639	HMEF 750	50
H.	8004231	HMEF Mini	50
HMEF's with Flex			
n/a	557019500	HMEF 1000 with flex tube and swivel	30
n/a	557070700	HMEF 500 with flex tube and gas sampling port	60
I.	557071500	HMEF 1000 with flex tube and gas sampling port	30
n/a	557071600	HMEF 1000 with flex tube	30
n/a	557085500	HMEF 1000 with Memoflex tube	40
J.	M1005260	HMEF 750 with Memoflex tube	50

Caption ID	Cat. No.	Tidal Volume (mL)	Dead Space (mL)	Weight (g)	Moisture Output (mg H ₂ O/L) Measures at VT (mL)	Moisture Loss (mg H ₂ O/L) Measures at VT (mL)	Pressure Drop (kPa/cmH ₂ O) Measures at VT (mL)	Gas Sampling Port	Patient Connection (mm)	Machine Connection (mm)	Filtration Efficiency Bacterial/Viral (%)	
A.	557070100	300-1000	77	24	33/32/30 500/750/1000	4.5/5.5/7.5 500/750/1000	0.10 (1.0) (2.3)	0.23	•	15M/22M	15M/22F	999999/9999
B.	557070500	120-500	30	15	31/30 250/500	6.5/7.5 250/500	0.15 (1.5) (3.3)	0.33		15F/22M	15M/22F	999999/9998
C.	M1004132	120-750	34	17	32/30/27 250/500/750	5.5/7.5/10.5 250/500/750	0.09 (0.9) (2.2)	0.22	•	15M/22M	15M/22F	999999/9998
D.	M1010534	300-1000	77	24	33/32/30 500/750/1000	4.5/5.5/7.5 500/750/1000	0.10 (1.0) (2.3)	0.23	•	15M/22M	15M/22F	999999/9999
E.	M1010538	120-750	34	17	32/30/27 250/500/750	5.5/7.5/10.5 250/500/750	0.09 (0.9) (2.2)	0.22	•	15M/22M	15M/22F	999999/9998
F.	M1038637	300-1000	77	24	33/32/30 500/750/1000	4.5/5.5/7.5 500/750/1000	0.10 (1.0) (2.3)	0.23		15M/22M	15M/22F	999999/9999
G.	M1038639	120-750	34	17	32/30/27 250/500/750	5.5/7.5/10.5 250/500/750	0.09 (0.9) (2.2)	0.22		15M/22M	15M/22F	999999/9998
H.	8004231	60-500	21	14	31/27 250/500	6.5/10.5 250/500	0.14 (1.4) (3.2)	0.32		15F/22M	15M/22F	999999/9998
HMEF's with Flex												
n/a	557019500	300-1000			33/32/30 500/750/1000	4.5/5.5/7.5 500/750/1000	0.10 (1.0) (2.3)	0.23				999999/9999
n/a	557070700	120-500			31/30 250/500	6.5/7.5 250/500	0.15 (1.5) (3.3)	0.33				999999/9998
I.	557071500	300-1000			33/32/30 500/750/1000	4.5/5.5/7.5 500/750/1000	0.10 (1.0) (2.3)	0.23	•			999999/9999
n/a	557071600	300-1000			33/32/30 500/750/1000	4.5/5.5/7.5 500/750/1000	0.10 (1.0) (2.3)	0.23				999999/9999
n/a	557085500	300-1000			33/32/30 500/750/1000	4.5/5.5/7.5 500/750/1000	0.10 (1.0) (2.3)	0.23				999999/9999
J.	M1005260	120-750			31/30 250/500	6.5/7.5 250/500	0.15 (1.5) (3.3)	0.33				999999/9998

Change frequency: 24 hours



A. 557070100 HMEF



B. 557070500 HMEF



C. M1004132 HMEF



D. M1010534 HMEF and E. M1010538 HMEF



F. M1038637 HMEF



G. M1038639 HMEF



H. 8004231 HMEF



I. 557071500 HMEF



J. M1005260 HMEF

Uni-Filters

Disposable bacterial/viral filters provide highly efficient protection against various types of microorganisms present in breathing circuits. These filters reduce the transfer of bacteria and viruses among patients, personnel and equipment. Uni-Filters use electrostatic means to capture harmful submicron particles, while its hydrophobic membranes repel humidity from the filter medium. The transparent housing allows visualization of humidity or secretions within filter.

Cat No	Description	Qty
557021200	Uni-Filter	45/cs
557022500	Uni-Filter with gas sampling port	60/cs
M1003346	Uni-Filter Junior	50/cs
M1003345	Mini-Filter with gas sampling port	50/cs
8570230	Uni-Filter with gas sampling port and Memoflex tube	50/cs

Specifications

Caption ID	Cat. No.	Dead Space (mL)	Weight (g)	Pressure Drop ² (kPa/cmH ₂ O) @ 30Lpm	Pressure Drop ² (kPa/cmH ₂ O) @ 60Lpm	Gas Sampling Port	Patient Connection (mm)	Machine Connection (mm)	Filtration Efficiency ¹ Bacterial/Viral (%)
A.	557021200	60	27	0.04/0.4	0.08/0.8	n/a	15F/22M	22F	9998/999
B.	557022500	35	16	0.07/0.7	0.19/1.9	luer	15F/22M	15M/22F	999999/99999
C.	M1003346	35	16	0.08/0.8	0.22/2.2	n/a	15F/22M	15M/22F	999999/99999
D.	M1003345	22	14	0.14/1.4	0.32/3.2	luer	15F/22M	15M/22F	999999/99999
n/a	8570230			0.07/0.7	0.19/1.9	luer	15F/22M	15F	999999/99999

¹ Measured by the method of Nelson Laboratories, Inc., USA. Records on file

² Measured according to standard EN ISO 9360-1:2009

Storage temperature: -30°C / -22°F to +40°C / +104°F. Shelf life: maximum 2 years. Expiration date printed on packaging.



A. 557021200 Uni-Filter



B. 557022500 Uni-Filter



C. M1003346 Uni-Filter



D. M1003345 Mini-Filter

Technical Data Sheet

AirLife™ HMEFs

Product Codes and Product Description	557070100 AirLife™ HMEF 1000/S, Disposable M1010534 AirLife™ Angled HMEF 1000/S M1038637 AirLife™ HMEF 1000, Disposable M1004132 AirLife™ HMEF 750/S, Disposable M1010538 AirLife™ Angled HMEF 750/S M1038639 AirLife™ HMEF 750 557070500 AirLife™ HMEF 500/S, Disposable 8004231 AirLife™ HMEF Mini/S, Disposable 557019500 AirLife™ HMEF 1000/S With Flexible Tube and Double Swivel Elbow, Disposable 557070700 AirLife™ HMEF 500/S With Memoflex Tube, Disposable 557071500 AirLife™ HMEF 1000/S With Flexible Tube, Disposable 557071600 AirLife™ HMEF 1000/S and Flexible Tube, Disposable 557085500 AirLife™ HMEF 1000/S With Memoflex Tube, Disposable 8570203 AirLife™ HMEF 1000/S With Flexible Tube and Elbow Connector, Disposable M1005260 AirLife™ HMEF 750/S With Memoflex Tube																																																
General Product Description	Heat and moisture exchangers with integrated bacterial/viral filter (HMEF) are used for patients requiring humidification during anesthesia or ventilation. The HMEFs help protect the patient, healthcare personnel and equipment from various microorganisms present in the breathing circuit. The HMEFs are placed between the proximal end of the artificial airway and the Y-piece of the breathing circuit. Both straight and angled products are provided. Some HMEFs have a gas sampling port for gas monitoring. HMEFs are disposable devices.																																																
Pack factor	557070100 50 M1010534 50 M1010538 50 M1038637 50 M1038639 50 M1004132 50 M1005260 50 557019500 30 557070500 75 8004231 50 557070700 60 557071500 30 557071600 30 557085500 40 8570203 30																																																
EAN/GTIN	<table border="0"> <tr> <td>557070100</td> <td>EA</td> <td>10885403286131</td> <td>557070500</td> <td>EA</td> <td>10885403284144</td> </tr> <tr> <td>557070100</td> <td>PAK</td> <td>70885403286133</td> <td>557070500</td> <td>PAK</td> <td>70885403284146</td> </tr> <tr> <td>M1010534</td> <td>CS</td> <td>50885403284210</td> <td>8004231</td> <td>EA</td> <td>10885403284168</td> </tr> <tr> <td>M1010534</td> <td>EA</td> <td>10885403284212</td> <td>8004231</td> <td>PAK</td> <td>70885403284160</td> </tr> <tr> <td>M1010538</td> <td>CS</td> <td>50885403284203</td> <td>557070700</td> <td>EA</td> <td>10885403255755</td> </tr> <tr> <td>M1010538</td> <td>EA</td> <td>10885403284205</td> <td>557070700</td> <td>PAK</td> <td>70885403255757</td> </tr> <tr> <td>M1038637</td> <td>EA</td> <td>10885403284427</td> <td>557071500</td> <td>EA</td> <td>10885403255762</td> </tr> <tr> <td>M1038637</td> <td>PAK</td> <td>70885403284429</td> <td>557071500</td> <td>PAK</td> <td>70885403255764</td> </tr> </table>	557070100	EA	10885403286131	557070500	EA	10885403284144	557070100	PAK	70885403286133	557070500	PAK	70885403284146	M1010534	CS	50885403284210	8004231	EA	10885403284168	M1010534	EA	10885403284212	8004231	PAK	70885403284160	M1010538	CS	50885403284203	557070700	EA	10885403255755	M1010538	EA	10885403284205	557070700	PAK	70885403255757	M1038637	EA	10885403284427	557071500	EA	10885403255762	M1038637	PAK	70885403284429	557071500	PAK	70885403255764
557070100	EA	10885403286131	557070500	EA	10885403284144																																												
557070100	PAK	70885403286133	557070500	PAK	70885403284146																																												
M1010534	CS	50885403284210	8004231	EA	10885403284168																																												
M1010534	EA	10885403284212	8004231	PAK	70885403284160																																												
M1010538	CS	50885403284203	557070700	EA	10885403255755																																												
M1010538	EA	10885403284205	557070700	PAK	70885403255757																																												
M1038637	EA	10885403284427	557071500	EA	10885403255762																																												
M1038637	PAK	70885403284429	557071500	PAK	70885403255764																																												

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyaire Medical, Inc.
 26125 North Riverwoods Blvd
 Mettawa, IL 60045
 USA



Vyaire Medical
 Kuortaneenkatu 2
 FI-00510 Helsinki
 Finland

Vyaire Medical Pty Ltd
 Level 5, 7 Eden Park Drive
 Macquarie Park, NSW, 2113
 Australia

Technical Data Sheet

AirLife™ HMEFs

	<p>M1038639 EA 10885403284434 557071600 EA 10885403255779 M1038639 PAK 70885403284436 557071600 PAK 70885403255771</p> <p>M1004132 EA 10885403284151 557085500 EA 10885403255793 M1004132 PAK 70885403284153 557085500 PAK 70885403255795</p> <p>M1005260 EA 10885403252952 8570203 EA 10885403255533 M1005260 PAK 70885403252954 8570203 PAK 70885403255535</p> <p>557019500 EA 10885403255724 557019500 PAK 70885403255726</p>
Intended Use	<p>The AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 and HMEF 1000 (hereafter referred to as HMEFs) are HME/Filter combinations. HMEFs are disposable single-use devices indicated for patients requiring humidification during the delivery of ventilation gases. They provide filtration for reducing possible infection with potential for cross-contamination between patient and equipment. The HMEFs are for use in hospital, ICU, anesthesia, respiratory therapy, during transport and with resuscitators. The HMEF 750, HMEF 500 and HMEF Mini can be used on adult and pediatric patients and the HMEF 1000 on adult patients.</p>
Instructions for Use	<p>Please refer to the Instructions for Use (IFU)</p>
Characteristics	<p>The HMEFs are indicated for use by qualified medical personnel only. The device is intended for short term use for more than sixty minutes and less than thirty days as defined by section 1.1 of Annex IX of the Medical Device Directive 93/42/EEC.</p>
Compatibility	<p>Humidification and filtration products have a commonly used 15mm/22mm ISO 5356-1 standard ports. They may be connected to standard breathing circuits.</p>
Shelf Life	<p>Shelf life for all products is three years. Expiration date is printed on the product labeling.</p>
Regulation	<p>The passive humidification and filtration products are class IIa by rule 2, short term, non-invasive, and non-active.</p>
Biocompatibility	<p>All materials are biocompatible, meeting skin irritation and sensitization requirements documents: DOC1591547, DOC1719945</p>
Materials	<p>557070100: PP Thermoplastic Borealis RF825MO, POLYURETHANE (polyester based), Calciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, Technostat 250, Polypropylene/Synth., EVA50%+LLDPE50%, M1010534: PP Thermoplastic RF825MO, POLYURETHANE (polyester based), Calciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, Technostat 250, Polypropylene/Synth., PP Borealis RF825MO, EVA50%+LLDPE50%, M1038637: PP Thermoplastic Borealis RF825MO, POLYURETHANE (polyester based), Calciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, Technostat 250, Polypropylene/Synth., PP, Borealis RF825MO,</p>

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA

 Vyaire Medical
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki
Finland

Vyaire Medical Pty Ltd
Level 5, 7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW, 2113
Australia

Technical Data Sheet

Airlife™ HMEFs

	<p>M1004132: PP Thermoplastic Borealis RF825MO, PP Thermoplastic Borealis RF 825 P, Technostat 250, Polypropylene/Synth., Calciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, POLYURETHANE BULPREN S75, EVA50%+LLDPE50%,</p> <p>M1010538: PP Thermoplastic Borealis RF 825 P, Technostat 250, Polypropylene/Synth., Calciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, POLYURETHANE BULPREN S75, PP Borealis RF825MO, EVA50%+LLDPE50%,</p> <p>M1038639: PP Thermoplastic Borealis RF825 P, Technostat 250, Polypropylene/Synth., PP, Borealis RF825MO, Calciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, POLYURETHANE BULPREN S75,</p> <p>557070500: PP, Borealis RF825MO, Borealis RF 856 P or equivalent, Technostat 250, Polypropylene/Synth., POLYURETHANE (polyester based), Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%,</p> <p>8004231: PP Borealis RF825MO, PP Borealis RF825MO, Technostat 250, Polypropylene/Synth., Polyurethane, Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%,</p> <p>557019500: EVA 1005 VN4 or equivalent -, PP Borealis RF825MO, PP Borealis RF825MO, Polyurethane, Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%, Technostat 250, Polypropylene/Synth., PP, Silicone,</p> <p>557070700: Clarified random polypropylene copolymer resin, Polyurethane (polyester based), Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, PP Borealis RF825MO, PP Borealis RF825MO, Technostat 250, Polypropylene/Synth., EVA50%+LLDPE50%,</p> <p>557071500, 557071600: EVA 1005 VN4 or equivalent -, PP Borealis RF825MO, PP Borealis RF825MO, Polyurethane, Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%, Technostat 250, Polypropylene/Synth.,</p> <p>557085500: Clarified random polypropylene copolymer resin, PP Borealis RF825MO, PP Borealis RF825MO, Polyurethane, Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%, Technostat 250, Polypropylene/Synth., EVA 1005 VN4 or equivalent -,</p> <p>8570203: EVA 1005 VN4 or equivalent -, PP Borealis RF825MO, PP Borealis RF825MO, Polyurethane, Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%, Technostat 250, Polypropylene/Synth., Polypropylene,</p> <p>M1005260: Clarified random Polypropylene copolymer resin, PP, Borealis RF825MO, PP Thermoplastic Borealis RF825P, Technostat 250 Polypropylene/Synth., Polyurethane Bulpren S75, Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%</p>
Storage	There are no special storage conditions or handling requirements. Packaging for non-sterile devices is intended to protect the product from dust and does not provide a sterile barrier.
GMDN Code	46816 Heat/moisture exchanger/microbial filter, non-sterile
Disposal	Dispose of in accordance with national and local authority regulations.
Does it contain PVC, DEHP and/or Latex	PVC Free, Latex Free, BPA Free, DEHP Free
Country of Origin	China
Legal Manufacturer	Vyair Medical Finland 320 Oy, Kuortaneenkatu 2, FI-00510 Helsinki, Finland

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyair Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA

  Vyair Medical
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki
Finland

Vyair Medical Pty Ltd
Level 5, 7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW, 2113
Australia

Technical Data Sheet

AirLife™ HMEFs

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA



Vyaire Medical
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki
Finland

Vyaire Medical Pty Ltd
Level 5, 7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW, 2113
Australia

Technical Data Sheet

AirLife™ Edith HME's & Edith Trach

Product Codes and Product Description	<p>557044500 AirLife™ EdithFlex HME with Integrated Flexible Tube, Disposable</p> <p>557085000 AirLife™ Edith 1500 HME with Memoflex, Disposable</p> <p>557057200 AirLife™ Edith 1500 HME, Disposable</p> <p>557055200 AirLife™ Edith 1000 HME, Disposable</p> <p>557056200 AirLife™ Edith 500 HME, Disposable</p> <p>557005000 AirLife™ EdithTrach HME for Spontaneously Breathing Patients, Disposable</p>																																				
General Product Description	<p>Heat and moisture exchangers (HME) are used for transferring heat and humidity from the gas expired by the patient to the the inspired gases. HMEs help create normal conditions in the patient's airways and lungs, reducing the risk of breathing complications. Edith HMEs are intended for artificially ventilated patients during intensive care or anesthesia. They are placed between the proximal end of the artificial airway and the Y-piece of the breathing circuit. An HME with an integrated flexible tube is also provided. The HMEs are disposable devices.</p> <p>The EdithTrach is a heat and moisture exchanger that is used for patients who are breathing spontaneously through a tracheostomy tube. EdithTrach is connected to the tracheostomy tube. EdithTrach is a disposable device.</p> <div data-bbox="1011 882 1552 1211" style="text-align: right;"> <p><i>The Edith Range</i></p> </div>																																				
Pack factor	<p>557044500 - 25</p> <p>557085000 - 80</p> <p>557057200 - 30</p> <p>557055200 - 30</p> <p>557056200 - 30</p> <p>557005000 - 75</p>																																				
EAN/GTIN	<table border="0"> <tr> <td>557044500</td> <td>EA</td> <td>10885403286148</td> <td>557055200</td> <td>EA</td> <td>10885403287008</td> </tr> <tr> <td>557044500</td> <td>PAK</td> <td>70885403286140</td> <td>557055200</td> <td>PAK</td> <td>70885403287000</td> </tr> <tr> <td>557085000</td> <td>EA</td> <td>10885403255786</td> <td>557056200</td> <td>EA</td> <td>10885403287015</td> </tr> <tr> <td>557085000</td> <td>PAK</td> <td>70885403255788</td> <td>557056200</td> <td>PAK</td> <td>70885403287017</td> </tr> <tr> <td>557057200</td> <td>EA</td> <td>10885403287121</td> <td>557070500</td> <td>EA</td> <td>10885403284144</td> </tr> <tr> <td>557057200</td> <td>PAK</td> <td>70885403287123</td> <td>557070500</td> <td>PAK</td> <td>70885403284146</td> </tr> </table>	557044500	EA	10885403286148	557055200	EA	10885403287008	557044500	PAK	70885403286140	557055200	PAK	70885403287000	557085000	EA	10885403255786	557056200	EA	10885403287015	557085000	PAK	70885403255788	557056200	PAK	70885403287017	557057200	EA	10885403287121	557070500	EA	10885403284144	557057200	PAK	70885403287123	557070500	PAK	70885403284146
557044500	EA	10885403286148	557055200	EA	10885403287008																																
557044500	PAK	70885403286140	557055200	PAK	70885403287000																																
557085000	EA	10885403255786	557056200	EA	10885403287015																																
557085000	PAK	70885403255788	557056200	PAK	70885403287017																																
557057200	EA	10885403287121	557070500	EA	10885403284144																																
557057200	PAK	70885403287123	557070500	PAK	70885403284146																																
Intended Use	<p>The Edith HMEs shall be used to humidify patients that are artificially ventilated during intensive care or anesthesia.</p>																																				

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA

 Vyaire Medical
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki
Finland

Vyaire Medical Pty Ltd
Level 5, 7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW, 2113
Australia

Technical Data Sheet

Airlife™ Edith HME's & Edith Trach

	EdithTrach is a single use heat and moisture exchanger which transfers heat and humidity from the gas expired by the patient to the inspired gases. EdithTrach is intended for use on patients who are breathing spontaneously through a tracheostomy tube.
Instructions for Use	Please refer to the Instructions for Use (IFU)
Characteristics	557044500, 557085000, 557057200, 557055200, 557056200: These are single use only, disposable devices intended for artificially ventilated patients and are indicated for use by qualified medical personnel only. 557005000: These are single use only, disposable devices intended for intended for use on patients who are breathing spontaneously through a tracheostomy tube and are indicated for use by qualified medical personnel only.
Compatibility	Humidification and filtration products have a commonly used 15mm/22mm ISO 5356-1 standard ports. They may be connected to standard breathing circuits.
Shelf Life	Shelf life for all products is three years. Expiration date is printed on the product labelling.
Regulation	The passive humidification and filtration products are class IIa by rule 2, short term, non-invasive, and non-active.
Biocompatibility	All materials are biocompatible, meeting skin irritation and sensitization requirements documents: DOC1591547, DOC1719953
Materials	557044500: EVATANE 1005 VN4 or equivalent, GRANULAT FLEX(551100600), BICOMPONENT FIBER PE/PP, BICOMPONENT FIBER PP/PE, polypropylene/polyethylene, polypropylene/polyethylene, Litiumchloride, KLOORHEXIDINGLUKONAT 557085000: Clarified random polypropylene copolymer resin, PP RB307MO, Bicomponent Fiber PP/PE, Bicomponent Fiber PP/PE, Bicomponent Fiber PP/PE, polypropylene/polyethylene, Litiumchloride, KLOORHEXIDINGLUKONAT 557057200: POLYPROPYLENE RB307MO or equivalent, Bicomponent fiber PP/PE, BICOMPONENT FIBER PP/PE, polypropylene/polyethylene, polypropylene/polyethylene, Litiumchloride, KLOORHEXIDINGLUKONAT 557055200: Bicomponent fiber PP/PE, Bicomponent fiber of Polypropylene (core) with Polyethylene (cover), polypropylene/polyethylene, Litiumchloride, Litiumchloride, KLOORHEXIDINGLUKONAT, POLYPROPYLENE RB307MO 557056200: POLYPROPYLENE RB307MO or equivalent, Bicomponent fiber PP/PE, BICOMPONENT FIBER PP/PE, polypropylene/polyethylene, polypropylene/polyethylene, Litiumchloride, KLOORHEXIDINGLUKONAT 557005000: PP, Borealis RF 825 P, Polylefin thermoplastic, Shore A85, Polyurethane, Calciumchloride
Storage	There are no special storage conditions or handling requirements. Packaging for non-sterile devices is intended to protect the product from dust and does not provide a sterile barrier.
GMDN Code	35530 Heat/moisture exchanger, single-use

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA

 Vyaire Medical
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki
Finland

Vyaire Medical Pty Ltd
Level 5, 7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW, 2113
Australia

Technical Data Sheet

AirLife™ Edith HME's & Edith Trach

Disposal	Dispose of in accordance with national and local authority regulations.
Does it contain PVC, DEHP and/or Latex	PVC Free, Latex Free, BPA Free, DEHP Free
Country of Origin	China
Legal Manufacturer	Vyaire Medical Finland 320 Oy, Kuortaneenkatu 2, FI-00510 Helsinki, Finland

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA



Vyaire Medical
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki
Finland

Vyaire Medical Pty Ltd
Level 5, 7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW, 2113
Australia

English	English	Български	Dansk	Ελληνικά	Español	Hrvatski jezik	Italiano	Latviešu valoda
---------	----------------	-----------	-------	----------	---------	----------------	----------	-----------------


Edith HMEs, disposable

Instructions for Use

REF	557056200	<i>AirLife™</i>	Edith 500 HME, Disposable
	557052000	<i>AirLife™</i>	Edith 1000 HME, Disposable
	557057200	<i>AirLife™</i>	Edith 1500 HME, Disposable
	557085000	<i>AirLife™</i>	Edith 1500 HME with Membralox™, Disposable
	557044500	<i>AirLife™</i>	EdithFlex HME with Integrated Flexible Tube, Disposable

REF	Catalogue Number		Caution
LOT	Batch Code		Consult Instructions for Use
X	Quantity		Exp. Date
	Manufacturer		For Single Use Only
			

Material
Housing: Polypropylene (PP)
HME element: Plastic
Not made with natural rubber latex.



HME = Heat and moisture exchanger

Intended use

Edith HMEs are single use Heat and Moisture Exchanger that transfer heat and humidity from the gas expired by the patient to the inspired gases. Edith HMEs shall not be used on patients with any facial trauma. The Edith HMEs shall be used to humidify patients that are transfery heat during intensive care or anesthesia.

Instructions for use

Read these instructions completely before using the product. Method of connection: Edith HMEs shall be placed between the proximal end of the artificial airway and the Y-piece of the breathing circuit. Edith HMEs shall be changed every 24 hours or more frequently as required. Shelf life: Max. 3 years. Expiration date printed on package.

Contraindications
Edith HMEs are contraindicated in patients producing minimal, frothy secretions within their airways and lungs. Edith HMEs shall not be used on patients with very small tidal volumes, for example neonates or very small children. Edith HMEs shall not be used together with active humidifiers or nebulizers.

Precautions
All tubing and connections to Edith HMEs shall be properly fixed and checked for leakage prior to use. Before use, verify that the HME has no occlusions and that an air flow through it. Compensation of ventilation may be necessary when using Edith HMEs since dead space will be added to the system. During the use of Edith HMEs, the patient shall be closely monitored and proper airway care administered if complications arise. The Edith HMEs must be changed between patients.

Warnings
Single-use products are not designed to be reused. Reuse may cause a risk of cross-contamination, affect the measurement accuracy and/or reduce performance, or cause a malfunction as a result of the product being physically damaged due to cleaning, disinfection, re-sterilization and/or reuse.

Technical data	557056200	557055200	557057200	557044500
Minimum Vt (ml)	70	110	150	150
Maximum Vt (ml)	500	1000	1500	1500
Dead space (ml)	17	28	38	90 ¹⁾
Weight (g)	6	8	9	20
Moisture to patient (mg H ₂ O)	30	30	30	30
Moisture loss (mg H ₂ O)	7.6	7.6	7.6	7.6
Pressure drop, measured at Vt (cm H ₂ O)	250	500	1000	1000
kPa (cm H ₂ O)				
- at 30 l/min	0.08	0.1	0.1	0.05
	(0.8)	(1.0)	(1.0)	(0.5)
- at 60 l/min	0.2	0.25	0.25	0.14
	(2.0)	(2.5)	(2.5)	(1.4)

¹⁾ The integrated flexible tube included.



²⁾ See additional Information Sheet for Dead Space.

Information for Further information

For further information, please contact your local sales representative or visit vyaire.com.

Trademarks are the property of their respective owners.

©2018 Vyair. Vyair, the Vyair logo and AirLife are trademarks or registered trademarks of Vyair Medical, Inc., or one of its affiliates.

			
10000037531A	2018-11		

1) The integrated flexible tube included.

²⁾ See additional Information Sheet for Dead Space.

Information for Further information

For further information, please contact your local sales representative or visit vyaire.com.

Trademarks are the property of their respective owners.

©2018 Vyair. Vyair, the Vyair logo and AirLife are trademarks or registered trademarks of Vyair Medical, Inc., or one of its affiliates.

			
10000037531A	2018-11		

English	English	Български	Dansk	Ελληνικά	Español	Hrvatski jezik	Italiano	Latviešu valoda
---------	----------------	-----------	-------	----------	---------	----------------	----------	-----------------

AirLife™ Edith HMEs, disposable

Топло- и влагообменници (HME) Edith, за еднократна употреба

Инструкции за употреба

Материал
Корпус: Полипропилен (PP)
Елемент: Пластмаса
Не е направено с естествени каучуков патек.
HME = топло- и влагообменник

Предназначение
HME Edith представлява топло- и влагообменник за еднократна употреба, който премахва топлина и влага от газа, издишан от пациента, към дишаемите газове.

HME Edith трябва да се използва за овлажняване на пациента, които са на изкуствена вентилация по време на интензивна грижи или анестезия.

Инструкции за употреба

Преди да използвате продукта, прочетете изцяло настоящите указания. Методи на свързване: Edith HMEs трябва да бъдат поставени между проксималния край на изкуствената въздушна път и троячния на дишаелния кръг. HME Edith трябва да се сменят на всеки 24 часа или по-често според необходимостта.

Срок на съхранение: Макс. 3 години. Датата на срока на годност е отпечатана на опаковката.

Противопоказания

HME Edith е противопоказан при пациенти, отделили сокровитни течности секрет в трахеята дишаелния път или в дробите. HME Edith не трябва да се използва при пациенти с много малки дишаелни обеми, например новородени или много малки деца.

HME Edith не трябва да се използва заедно с активни овлажняватели или небулайзери.

Предпазни мерки
Всички тръби и свързвания към HME Edith трябва да бъдат правилно фиксираны и проверени за тея преди употреба.

Преди употреба проверете дали HME няма запушвания и дали въздухът ще преминава през него.

Може да се наложи компенсация на вентилацията при използването на HME Edith, тъй като системата ще о овлажнява мъртво пространство.

Предупреждения
Продуктите за еднократна употреба не са предназначени за повторна употреба. Повторната употреба може да причини риск от кръстосано заразяване, може да се отрази на точността на измерването и/или на характеристиките на системата или да причини неизправност в резултат на физическо увреждане на продукта, приложено от почистване, дезинфекциране или повторна стерилизация или повторна употреба.

Технически данни	557056200	557055200	557057200	557044500
Minimum Vt (ml)	70	110	150	150
Maximum Vt (ml)	500	1000	1500	1500
Dead space (ml)	17	28	38	90 ¹⁾
Weight (g)	6	8	9	20
Vaigt til patienten (mg H ₂ O)	30	30	30	30
Moisture loss (mg H ₂ O)	7.6	7.6	7.6	7.6
Pressure drop, measured at Vt (cm H ₂ O)	250	500	1000	1000
kPa (cm H ₂ O)				
- at 30 l/min	0.08	0.1	0.1	0.05
	(0.8)	(1.0)	(1.0)	(0.5)
- at 60 l/min	0.2	0.25	0.25	0.14
	(2.0)	(2.5)	(2.5)	(1.4)

¹⁾ Den integrerede fleksible slange er inkluderet.

²⁾ Se det supplerende oplysningsark for dead space.

Bestillingsoplysninger

Kontakt din lokale salgsrepræsentant, eller besøg vyaire.com, for yderligere oplysninger.

Varemærker tilhører deres respektive ejere.

©2018 Vyair. Vyair, Vyair- logoet og AirLife er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Vyair Medical, Inc. eller et af dets datterselskaber.

¹⁾ Включена интегриранта гъвкава тръба.

²⁾ Вижте допълнителните информационни лист относно мъртвото пространство.

Информация за поръчка

За допълнителна информация се свържете с местния търговски представител или посетете vyaire.com.

Търговските марки са собственост на съответните им притежатели.

© 2018 Vyair. Vyair, logo to Vyair и AirLife са търговски марки или регистрирани търговски марки на Vyair Medical, Inc. или нейните дъщерни фирми.

Technical data	557056200	557055200	557057200	557044500
Minimum Vt (ml)	70	110	150	150
Maximum Vt (ml)	500	1000	1500	1500
Dead space (ml)	17	28	38	90 ¹⁾
Weight (g)	6	8	9	20
Moisture to patient (mg H ₂ O)	30	30	30	30
Moisture loss (mg H ₂ O)	7.6	7.6	7.6	7.6
Pressure drop, measured at Vt (cm H ₂ O)	250	500	1000	1000
kPa (cm H ₂ O)				
- at 30 l/min	0.08	0.1	0.1	0.05
	(0.8)	(1.0)	(1.0)	(0.5)
- at 60 l/min	0.2	0.25	0.25	0.14
	(2.0)	(2.5)	(2.5)	(1.4)

Edith HME, Na jedno použití

Pokyny k použití

Obal: Polypropylen (PP)
Element HME: Plastická hmota

Není vyrobeno z přírodních kaučuků (latexu).

HME = výměník tepla a vlhkosti

Zamýšlené použití

Edith HMEs je výměník tepla a vlhkosti na jedno použití, který převádí teplo a vlhkost z dýchavých vydechovaných pacientem do vdechovaných plynu. Edith HME se používá u pacientů v průběhu umělé ventilace při intenzivní péči nebo anestezii.

Pokyny k použití

Před použitím tohoto výrobku je nutno si pečlivě přečíst tento návod. Než začnete používat Edith HME, je třeba si velmi malými dechovými oběmy, například u novorozenců nebo u velmi malých dětí. Edith HME nesmí být používány společně s aktivními zvlhčovači nebo nebulátory.

Bezpečnostní opatření
Všchny hadičky a spojky k Edith HME musí být před použitím správně zapojeny a zkontrolovány z hlediska těsnosti.

Před použitím zkontrolujte HME z hlediska otkuku a volného průchodu vzduchu. Protizhote bude při použití Edith HME přidan k systému dodatečný mrtvý prostor, ve vhodně provést kompenzaci ventilace.

V průběhu použití Edith HME musí být pacient pečlivě sledován a v případě vzniku problému mu musí být poskytnuta adekvátní péče. Mezi jednotlivými pacienty musí být filtry Edith HME vyměňeny.

Contraindikace
Edith HME jsou kontraindikovány u pacientů produkcijících v dechových cestách a plicích větší množství pěňných sekretů.

HME Edith nesmí být používány u pacientů s velmi malými dechovými oběmy, například u novorozenců nebo u velmi malých dětí. Edith HME nesmí být používány společně s aktivními zvlhčovači nebo nebulátory.

Bezpečnostní opatření
Všchny hadičky a spojky k Edith HME musí být před použitím správně zapojeny a zkontrolovány z hlediska těsnosti.

Před použitím zkontrolujte HME z hlediska otkuku a volného průchodu vzduchu. Protizhote bude při použití Edith HME přidan k systému dodatečný mrtvý prostor, ve vhodně provést kompenzaci ventilace.

V průběhu použití Edith HME musí být pacient pečlivě sledován a v případě vzniku problému mu musí být poskytnuta adekvátní péče. Mezi jednotlivými pacienty musí být filtry Edith HME vyměňeny.

Technické parametry	557056200	557055200	557057200	557044500
Minimum Vt (ml)	70	110	150	150
Maximum Vt (ml)	500	1000	1500	1500
Mrtvý prostor (ml)	17	28	38	90 ¹⁾
Váha (g)	6	8	9	20
Vlhkost k pacientovi (mg H ₂ O)	30	30	30	30
Moisture loss (mg H ₂ O)	7.6	7.6	7.6	7.6
Pressure drop, measured at Vt (cm H ₂ O)	250	500	1000	1000
kPa (cm H ₂ O)				
- at 30 l/min	0.08	0.1	0.1	0.05
	(0.8)	(1.0)	(1.0)	(0.5)
- at 60 l/min	0.2	0.25	0.25	0.14
	(2.0)	(2.5)	(2.5)	(1.4)

¹⁾ Integriertem flexiblen Schlauch.

²⁾ Weitere Informationen finden Sie im Informationsblatt zum Totraum.

Bestellinformationen

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer lokalen Vyair-Vertretung oder unter vyaire.com.

Die Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

©2018 Vyair. Vyair, das Vyair-Logo und AirLife sind Marken oder eingetragene Marken von Vyair Medical, Inc. oder eines seiner Tochterunternehmen.

¹⁾ Včetně integrovaného ohněvň hadice.

²⁾ Viz další informace v informačním listu pro mrtvý prostor.

Informace o zjednávateli
Další informace získáte od svého místního obchodního zástupce nebo na webu vyaire.com.

Ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

©2018 Vyair. Vyair, logo Vyair a AirLife jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Vyair Medical, Inc. nebo některé z jejích dceřných společností.

English	English	Български	Dansk	Ελληνικά	Español	Hrvatski jezik	Italiano	Latviešu valoda
---------	----------------	-----------	-------	----------	---------	----------------	----------	-----------------

AirLife™ Edith HMEs, disposable

Топло- и влагообменници (HME) Edith, за еднократна употреба

Brugervejledning

Material
Hus: Polypropylen (PP)
HME-element: plastic
Ikke fremstillet med naturligt latexgummi.

HME = varme- og fugtudeveksler
HME = varme- og fugtudeveksler

Tilslaget anvendelse

Edith HME er et varme- og fugtudeveksler til engangsbrug, som overfører varme og fugt fra den gas, som patienten udsånder, til de indåandede gasser. Edith HMEs skal bruges til at fugte patienter der er kunstigt ventilerede under intensivt pleje eller anestesi.

Brugervejledning
Tilslut vejledningen helt igennem, før produktet tages i brug. Tilslutningskempejper: Edith HMEs skal placeres imellem den proksimale ende af den kunstige luftvej og Y-stykket på ventilationsslangen. Edith HMEs skal skiftes hver 24 time eller oftere hvis det er nødvendigt.

Holdbarhed: Hvert 3 år. Udløbsdato er trykt på emballagen.

Kontraindikationer
Edith HMEs må ikke anvendes til patienter med kraftig sekretudskrivning i luftvejne og lunger.
Edith HME må ikke anvendes til patienter med meget lille åndedrætsvolumen, f.eks. nyfødte eller små børn.

Edith HME må ikke anvendes sammen med aktive fugttilførsels- eller nebulisatorer.

Førbrugsregler

Før brug kontrolleres det, at alle slanger og koblinger til Edith HME er faste og lette.

Før brug skal verificeres at filteret ikke har nogen tilstopninger og at luft vil strømme gennem det.
Kompensation for deadspace, der tilføres systemet ved anvendelse af Edith HME, kan være nødvendig.

Under anvendelse af Edith HME skal patienten overvåges nøje, og korrekt behandling af luftvejsrespiration eller forårsagede fejltilfælde som et resultat af et produkt er fysisk skadet som følge af rengøring, desinficering, re-sterilisation og/eller brug.

Advvarsler
Engangslibetbar er ikke beregnet til at blive genanvendt. Genanvendelse kan forårsage risiko for kryds-kontaminering, påvirket nøjagtighed af målinger og/eller systemrespiration eller forårsagede fejltilfælde som et resultat af et produkt er fysisk skadet som følge af rengøring, desinficering, re-sterilisation og/eller brug.

Techniske data	557056200	557055200	557057200	557044500
Minimum Vt (ml)	70	110	150	150
Maximum Vt (ml)	500	1000	1500	1500
Deadspace (ml)	17	28	38	90 ¹⁾
Vaigt (g)	6	8	9	20
Vugt til patienten (mg H ₂ O)	30	30	30	30
Moisture loss (mg H ₂ O)	7.6	7.6	7.6	7.6
Pressure drop, measured at Vt (cm H ₂ O)	250	500	1000	1000
kPa (cm H ₂ O)				
- ved 30 l/min	0.08	0.1	0.1	0.05
	(0.8)	(1.0)	(1.0)	(0.5)
- ved 60 l/min	0.2	0.25	0.25	0.14
	(2.0)	(2.5)	(2.5)	(1.4)

¹⁾ Den integrerede fleksible slange er inkluderet.

Norsk	pt	Português		
AirLife™	AirLife™	AirLife™		
Edith HME's, engangs	HMEs Edith, descartável	Edith HMEs, dispozabile		
Bruksanvisning	Instruções de utilização	Instrucciones de utilizar		
Materiale	Material	Material		
Hus: Polypropylen (PP). HME-element: Plast.	Hus: Polypropylen (PP). Elemento HME: Plástico.	Hus: Polypropylen (PP). Element HME: Plástico.		
Ikke fremstillet med naturlig gummitilset.	Não fabricado com látex de borracha natural.	Nu este fabricat cu latex din caucuc natural.		
HME= Varme- og fuktighetsveksler (Heat and Moisture Exchanger)	HME= humidificador	HME= schimbător de căldură și umiditate		
Titeltekst	Finalidade a que se destina	Destinația de utilizare		
Edith HME er en fukt- og varmeveksler til patienter, som overfører varme og fuktighet fra gassen som ekspireres fra engangspatient, til de inspirerte gasser inspireres.	Os HMEs Edith são permeadores de calor e humidade, de utilização única, que transferem o calor a a humidade dos gases expirados pelo paciente para os gases inspirados.	Os HMEs Edith sunt dispozitive de încălzire și umiditate de utilizare unică, care transferă căldura și umiditate de la gazul expirat de pacient la gazele inspirate.		
Os HMEs Edith devem ser utilizados para humidificar pacientes ventilados artificialmente em cuidados intensivos ou anestesiados.	Os HMEs Edith devem ser utilizados para humidificar pacientes ventilados artificialmente em cuidados intensivos ou anestesiados.	Edith HME vor fi utilizate pentru a umidifica pacienții care sunt ventilați artificial în timpul terapiei intensive sau anestezice.		
Bruksanvisning	Instruções de utilização	Instrucți de utilizare		
Läs disse instruksjonene komplett før produktet tas i bruk.	Leia estas instruções completamente antes de utilizar o produto.	Prezabte uputstvo i uputstvo za održavanje proizvoda.		
Les instructions relatives à l'usage des HMEs Edith doivent être consultées en cas d'extrême proximité de la voie aérienne artificielle et à la péca en Y du circuit respiratoire.	Os HMEs Edith devem ser substituídos de 24 em 24 horas ou mais frequentemente, se necessário.	Edith HME vor se vor utiliza la pacienții care au o extremitate proximală de la calea aerului artificială și piesa în Y a circuitului respirator. Edith HME vor fi schimbate la fiecare 24 ore sau mai des dacă este necesar.		
Les instructions relatives à l'usage des HMEs Edith doivent être consultées en cas d'extrême proximité de la voie aérienne artificielle et à la péca en Y du circuit respiratoire.	Os HMEs Edith devem ser utilizados para humidificar pacientes ventilados artificialmente em cuidados intensivos ou anestesiados.	Durată de utilizare maximă: max. 3 ani. Data expirării este tipărită pe ambalaj.		
Edith HME skal benyttes for at fuktige patienter som ventilatorbehandles ved intensivbehandling eller under anæstesi.	Os HMEs Edith devem ser utilizados em doentes com volumes correntes muito reduzidos, tal como recém-nascidos.	Os HMEs Edith nu se utilizază împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.		
Kontraindikasjoner	Contra-indicações	Contraindicatii		
Edith HME er kontraindisert til pasienter med fulminant, skummende sekresjon fra sine lunger og luftrør.	Encontre-se contra-indicada a utilização de HMEs Edith em doentes que produzam secreções espumosas fulminantes nas vias respiratórias e noentes com pulmões.	Edith HMEs sunt contraindicate la pacienții care au secreții cu spumă, fulminante în calea respiratorie sau plămâni.		
Edith HME skal benyttes til pasienter med veldig små tidalvolum, f.eks. neonatale eller meget små luftrør.	Encontre-se contra-indicada a utilização de HMEs Edith em doentes que apresentem volumes correntes muito reduzidos, tal como recém-nascidos.	Edith HME nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.		
Edith HME skal benyttes sammen med aktive fuktvere eller kontrolleres for lekkasje før bruk.	Os HMEs Edith não devem ser utilizados em doentes com volumes correntes muito reduzidos, tal como recém-nascidos.	Edith HME nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.		
Før bruk, kontroller at filteret ikke har blokkeringer og at luft kan passere gjennom det.	Precauções	Precauții		
Kompensering av ventilasjonen kan være nødvendig ved bruk av Edith HME, da dødtrommet i systemet vil øke.	Todos os tubos e ligações aos HMEs Edith devem ser ligados e fixos correctamente e deve verificar-se a existência de fugas antes de qualquer utilização.	Verificarea tuburilor și conectarea Edith HMEs vor fi corect atașate și vor fi verificate pentru pierderi, înainte de utilizare.		
Ved bruk av Edith HME skal pasienten overvåkes nøye, og riktig behandling av lufteveien kunne ivretakes hvis det oppstår komplikasjoner.	Antes de utilizar, certifique-se de que não há obstruções e que o fluxo de ar contém normalmente.	Înainte de utilizare, verificați dacă HME nu are ocuzii și fluxul de aer circula prin el.		
Edith HME skal skiftes mellom hver pasient.	Poderá ser necessário realizar uma compensação da ventilação quando se utilizar os HMEs Edith, uma vez que a sua introdução no circuito corresponde à adição de espaço morto no sistema.	Compensarea ventilării poate fi necesară când se utilizează Edith HMEs, deoarece introducerea în circuit a dispozitivului va fi echivalentă la introducerea în timpul utilizării Edith HMEs pacienților vor fi îndepărate montajul și calea aerului vor fi curățate în cazul în care apar complicații.		
Advarsler	Forholdsregler	Precauții		
Engangsprodukter er ikke ment å brukes på nytt. Gjennom kan føre til risiko for krysskontaminering, påvirket nøyaktighet av målinger og/eller systemets ytelise eller forlanske funksjonstilsett som er resultat av at produktet har blitt skadet på grunn av rengjøring, desinfisering, resterilisering og/eller gjenbruk.	Produsele de unică folosință nu sunt destinate reutilizării. Reutilizarea acestora prezintă riscuri de contaminare încrucișată, poate afecta acuratețea măsurătorilor și/sau performanța sistemului sau poate duce la funcționare defectuoasă ca urmare a deteriorării produsului din cauza curățării, dezinfectării, sterilizării și/sau reutilizării.	Produsele de unică folosință nu sunt destinate reutilizării. Reutilizarea acestora prezintă riscuri de contaminare încrucișată, poate afecta acuratețea măsurătorilor și/sau performanța sistemului sau poate duce la funcționare defectuoasă ca urmare a deteriorării produsului din cauza curățării, dezinfectării, sterilizării și/sau reutilizării.		
Minimumt Volum (ml)	50756200	507565200	50757200	507544500
Maximumt Volum (ml)	500	1000	1500	1500
Deotrom (ml)	17	28	38	90 ¹⁾
Vekt (g)	6	8	9	20
Fuktighet til pasient (mg H ₂ O/l)	3	3	3	30
Fuktighet per pasient (mg H ₂ O/l)	7.6	7.6	7.6	7.6
Spesifisert kapasitet (mg H ₂ O/l)	250	500	1000	1000
Prøve ved VT (ml)	1	2	3	90 ¹⁾
Trykkløst (kPa (cm H ₂ O))	0.08	0.1	0.1	0.05
- ved 30 l/min	(0.8)	(1.0)	(1.0)	(0.5)
- ved 60 l/min	(2.0)	(2.5)	(2.5)	(1.4)
¹⁾ Inkludert den fleksible slangen.				
²⁾ Se informasjonen kart på dødtrom.				

Bestillingsinformasjon

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte den lokale salgspresentanten eller gå til vyaire.com.

Varemerker tilhører sine respektive eiere.

©2018 Vyaire. Vyaire, Vyair-loopen og AirLife er varemerker eller registrerte varemerker for Vyair Medical, Inc., eller et av dets datterselskaper.

«Consulta a Folha de Informações adicional para conhecer o espaço morto.»

Informação para encomenda

Para mais informações, contacte o representante de vendas local da Vyair Medical ou visite vyaire.com.

As marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

©2018 Vyair. Vyair, Vyair-loopen og AirLife são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Vyair Medical, Inc. ou de uma das suas subsidiárias.

«Consulta a Folha de Informações adicional para conhecer o espaço morto.»

Informații pentru comandă

Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul local de vânzare sau vizitați vyaire.com.

Mărcile comerciale aparțin proprietarilor lor de drept.

©2018 Vyair. Vyair, sigla Vyair și AirLife sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Vyair Medical, Inc. sau a unuia dintre afiliații săi.

«Consultați fișa de informații suplimentare pentru spațiul mort.»

Mărcile comerciale aparțin proprietarilor lor de drept.

©2018 Vyair. Vyair, logo Vyair și AirLife su ohranjeni znaki za blagovne znamke ali registrirane ohranjeni znaki družbe Vyair Medical, Inc. ali enega od njenih podružnic.

«Preberite uputstvo za uporabo in uputstvo za vzdrževanje proizvoda.»

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Norsk	pt	Português		
AirLife™	AirLife™	AirLife™		
Edith HME's, engangs	HMEs Edith, descartável	Edith HMEs, dispozabile		
Bruksanvisning	Instruções de utilização	Instrucciones de utilizar		
Materiale	Material	Material		
Hus: Polypropylen (PP). HME-element: Plast.	Hus: Polypropylen (PP). Elemento HME: Plástico.	Hus: Polypropylen (PP). Element HME: Plástico.		
Ikke fremstillet med naturlig gummitilset.	Não fabricado com látex de borracha natural.	Nu este fabricat cu latex din caucuc natural.		
HME= Varme- og fuktighetsveksler (Heat and Moisture Exchanger)	HME= humidificador	HME= schimbător de căldură și umiditate		
Titeltekst	Finalidade a que se destina	Destinația de utilizare		
Edith HME er en fukt- og varmeveksler til patienter, som overfører varme og fuktighet fra gassen som ekspireres fra engangspatient, til de inspirerte gasser inspireres.	Os HMEs Edith são permeadores de calor e humidade, de utilização única, que transferem o calor a a humidade dos gases expirados pelo paciente para os gases inspirados.	Os HMEs Edith sunt dispozitive de încălzire și umiditate de utilizare unică, care transferă căldura și umiditate de la gazul expirat de pacient la gazele inspirate.		
Os HMEs Edith devem ser utilizados para humidificar pacientes ventilados artificialmente em cuidados intensivos ou anestesiados.	Os HMEs Edith devem ser utilizados para humidificar pacientes ventilados artificialmente em cuidados intensivos ou anestesiados.	Edith HME vor fi utilizate pentru a umidifica pacienții care sunt ventilați artificial în timpul terapiei intensive sau anestezice.		
Bruksanvisning	Instruções de utilização	Instrucți de utilizare		
Läs disse instruksjonene komplett før produktet tas i bruk.	Leia estas instruções completamente antes de utilizar o produto.	Prezabte uputstvo i uputstvo za održavanje proizvoda.		
Les instructions relatives à l'usage des HMEs Edith doivent être consultées en cas d'extrême proximité de la voie aérienne artificielle et à la péca en Y du circuit respiratoire.	Os HMEs Edith devem ser substituídos de 24 em 24 horas ou mais frequentemente, se necessário.	Edith HME vor se vor utiliza la pacienții care au o extremitate proximală de la calea aerului artificială și piesa în Y a circuitului respirator. Edith HME vor fi schimbate la fiecare 24 ore sau mai des dacă este necesar.		
Les instructions relatives à l'usage des HMEs Edith doivent être consultées en cas d'extrême proximité de la voie aérienne artificielle et à la péca en Y du circuit respiratoire.	Os HMEs Edith devem ser utilizados para humidificar pacientes ventilados artificialmente em cuidados intensivos ou anestesiados.	Durată de utilizare maximă: max. 3 ani. Data expirării este tipărită pe ambalaj.		
Edith HME skal benyttes for at fuktige patienter som ventilatorbehandles ved intensivbehandling eller under anæstesi.	Os HMEs Edith não devem ser utilizados em doentes com volumes correntes muito reduzidos, tal como recém-nascidos.	Os HMEs Edith nu se utilizază împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.		
Kontraindikasjoner	Contra-indicações	Contraindicatii		
Edith HME er kontraindisert til pasienter med fulminant, skummende sekresjon fra sine lunger og luftrør.	Encontre-se contra-indicada a utilização de HMEs Edith em doentes que produzam secreções espumosas fulminantes nas vias respiratórias e noentes com pulmões.	Edith HMEs sunt contraindicate la pacienții care au secreții cu spumă, fulminante în calea respiratorie sau plămâni.		
Edith HME skal benyttes til pasienter med veldig små tidalvolum, f.eks. neonatale eller meget små luftrør.	Encontre-se contra-indicada a utilização de HMEs Edith em doentes que apresentem volumes correntes muito reduzidos, tal como recém-nascidos.	Edith HME nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.		
Edith HME skal benyttes sammen med aktive fuktvere eller kontrolleres for lekkasje før bruk.	Os HMEs Edith não devem ser utilizados simultaneamente com um humidificador ativo ou com nebulizadores.	Edith HME nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.		
Før bruk, kontroller at filteret ikke har blokkeringer og at luft kan passere gjennom det.	Precauções	Precauții		
Kompensering av ventilasjonen kan være nødvendig ved bruk av Edith HME, da dødtrommet i systemet vil øke.	Todos os tubos e ligações aos HMEs Edith devem ser ligados e fixos correctamente e deve verificar-se a existência de fugas antes de qualquer utilização.	Verificarea tuburilor și conectarea Edith HMEs vor fi corect atașate și vor fi verificate pentru pierderi, înainte de utilizare.		
Ved bruk av Edith HME skal pasienten overvåkes nøye, og riktig behandling av lufteveien kunne ivretakes hvis det oppstår komplikasjoner.	Antes de utilizar, certifique-se de que não há obstruções e que o fluxo de ar contém normalmente.	Înainte de utilizare, verificați dacă HME nu are ocuzii și fluxul de aer circula prin el.		
Edith HME skal skiftes mellom hver pasient.	Poderá ser necessário realizar uma compensação da ventilação quando se utilizar os HMEs Edith, uma vez que a sua introdução no circuito corresponde à adição de espaço morto no sistema.	Compensarea ventilării poate fi necesară când se utilizează Edith HMEs, deoarece introducerea în circuit a dispozitivului va fi echivalentă la introducerea în timpul utilizării Edith HMEs pacienților vor fi îndepărate montajul și calea aerului vor fi curățate în cazul în care apar complicații.		
Advarsler	Forholdsregler	Precauții		
Engangsprodukter er ikke ment å brukes på nytt. Gjennom kan føre til risiko for krysskontaminering, påvirket nøyaktighet av målinger og/eller systemets ytelise eller forlanske funksjonstilsett som er resultat av at produktet har blitt skadet på grunn av rengjøring, desinfisering, resterilisering og/eller gjenbruk.	Produsele de unică folosință nu sunt destinate reutilizării. Reutilizarea acestora prezintă riscuri de contaminare încrucișată, poate afecta acuratețea măsurătorilor și/sau performanța sistemului sau poate duce la funcționare defectuoasă ca urmare a deteriorării produsului din cauza curățării, dezinfectării, sterilizării și/sau reutilizării.	Produsele de unică folosință nu sunt destinate reutilizării. Reutilizarea acestora prezintă riscuri de contaminare încrucișată, poate afecta acuratețea măsurătorilor și/sau performanța sistemului sau poate duce la funcționare defectuoasă ca urmare a deteriorării produsului din cauza curățării, dezinfectării, sterilizării și/sau reutilizării.		
Minimumt Volum (ml)	50756200	507565200	50757200	507544500
Maximumt Volum (ml)	500	1000	1500	1500
Deotrom (ml)	17	28	38	90 ¹⁾
Vekt (g)	6	8	9	20
Fuktighet til pasient (mg H ₂ O/l)	3	3	3	30
Fuktighet per pasient (mg H ₂ O/l)	7.6	7.6	7.6	7.6
Spesifisert kapasitet (mg H ₂ O/l)	250	500	1000	1000
Prøve ved VT (ml)	1	2	3	90 ¹⁾
Trykkløst (kPa (cm H ₂ O))	0.08	0.1	0.1	0.05
- ved 30 l/min	(0.8)	(1.0)	(1.0)	(0.5)
- ved 60 l/min	(2.0)	(2.5)	(2.5)	(1.4)
¹⁾ Inkludert den fleksible slangen.				
²⁾ Se informasjonen kart på dødtrom.				

Bestillingsinformasjon

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte den lokale salgspresentanten eller gå til vyaire.com.

Varemerker tilhører sine respektive eiere.

©2018 Vyair. Vyair, Vyair-loopen og AirLife er varemerker eller registrerte varemerker for Vyair Medical, Inc., eller et av dets datterselskaper.

«Consulta a Folha de Informações adicional para conhecer o espaço morto.»

Informații pentru comandă

Para mais informações, contacte o representante de vendas local da Vyair Medical ou visite vyaire.com.

As marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

©2018 Vyair. Vyair, logo Vyair e AirLife são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Vyair Medical, Inc. ou de uma das suas subsidiárias.

«Consulta a Folha de Informações adicional para conhecer o espaço morto.»

Informații pentru comandă

Para mais informações, contacte o representante de vendas local da Vyair Medical ou visite vyaire.com.

As marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

©2018 Vyair. Vyair, o logotipo Vyair e AirLife são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Vyair Medical, Inc. ou de uma das suas subsidiárias.

«Consulta a Folha de Informações adicional para conhecer o espaço morto.»

Informații pentru comandă

Para mais informações, contacte o representante de vendas local da Vyair Medical ou visite vyaire.com.

As marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

©2018 Vyair. Vyair, logo Vyair e AirLife su ohranjeni znaki za blagovne znamke ali registrirane ohranjeni znaki družbe Vyair Medical, Inc. ali enega od njenih podružnic.

«Preberite uputstvo za uporabo in uputstvo za vzdrževanje proizvoda.»

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilizează împreună cu umidificatoare active sau nebulizatoare.

Os HMEs Edith nu se utilize

HMEFs, Disposable

Instructions for Use

REF	8004231	AirLife™ HMEF Mini/S, Disposable
	557070500	AirLife™ HMEF 500/S, Disposable
	557070700	AirLife™ HMEF 500/S with Memoflex Tube, Disposable
	M1038639	AirLife™ HMEF 750, Disposable
	M1004132	AirLife™ HMEF 750/S, Disposable
	M1005260	AirLife™ HMEF 750/S with Memoflex Tube, Disposable
	M1010538	AirLife™ Angled HMEF 750/S, Disposable
	M1038637	AirLife™ HMEF 1000, Disposable
	557070100	AirLife™ HMEF 1000/S, Disposable
	557071500	AirLife™ HMEF 1000/S with Flexible Tube, Disposable
	557071600	AirLife™ HMEF 1000/S and Flexible Tube, Disposable
	557085500	AirLife™ HMEF 1000/S with Memoflex Tube, Disposable
	8570203	AirLife™ HMEF 1000/S with Flexible Tube and Elbow Connector, Disposable
	557019500	AirLife™ HMEF 1000/S with Flexible Tube and Double Swivel Elbow, Disposable
	M1010534	AirLife™ Angled HMEF 1000/S, Disposable

REF	Catalogue Number		Caution
LOT	Lot Number		Consult Instructions for Use
X	Quantity		Exp. Date
	Manufacturer		For Single Use Only
			U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.


Material

Housing: Polypropylene (PP)

HME element: Polyurethane (PU)

Filter element: Polypropylene/synthetic (PP)

Not made with natural rubber latex.

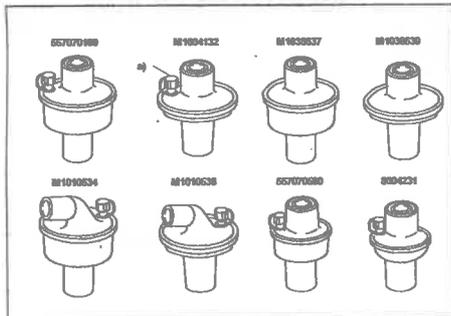

a) Gas sampling port

HMEF= Heat and moisture exchanger with integrated bacterial/viral filter

Intended use

The AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 and HMEF 1000 (hereafter referred to as HMEFs) are HME/Filter combinations. HMEFs are disposable single-use devices indicated for patients requiring humidification during the delivery of ventilator gases. They provide filtration for reducing possible cross contamination between patient and equipment. The HMEFs are for use in hospital, ICU, anesthesia, respiratory therapy, during transport and with resuscitators. The HMEF 750, HMEF 500 and HMEF Mini can be used on adult and pediatric patients and the HMEF 1000 on adult patients. The HMEFs are indicated for use by qualified medical personnel only.

Instructions for use

Read these instructions carefully before using the product. Place the HMEF between the proximal end of the artificial airway and the Y-piece of the breathing circuit.

Always replace the HMEF after each patient.

When used continuously on a single patient, change the HMEF every 24 hours or more frequently as required.

Contraindications

The HMEFs are contraindicated in patients producing fulminating, frothy secretions within their airways and lungs.

The HMEFs shall not be used on patients with very small tidal volumes, for example neonates.

The HMEFs shall not be used together with active humidifiers or nebulizers.

Precautions

All tubing and connections to the HMEF shall be properly attached and checked for leakage prior to use. Before use, verify that the HMEF has no occlusions and that air will flow through it.

Compensation of ventilation may be necessary when using the HMEF since dead space will be added to the system.

During the use of the HMEF, the patient shall be closely monitored and proper airway care administered if complications arise.

If a sampling tube is not connected, make sure that the sampling port cap on the HMEF is properly secured.

Топло- и влагообменници с интегриран филтър (HMEF), за еднократна употреба

Инструкции за употреба

Материал

Корпус: Полипропилен (PP)

Елемент на HME: Полиуретан (PU)

Елемент на филтъра: Полипропилен/синтетика

Не е направено с естествен каучуков латекс.

a) Порт за газови проби

HMEF= Топло- и влагообменник с интегриран бактериален/вирусен филтър

Предназначение

AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 и HMEF 1000 (оттук нататък наричани накратко HMEF) са комбинации от HME/филтри. HMEF представляват устройства за еднократна употреба, показани за пациенти, изискващи овлажняване по време на подаване на газове от респиратор. Те осигуряват филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. HMEF са предназначени за употреба в болница, отделения за интензивни грижи, анестезия, респираторна терапия, по време на транспорт и с реаниматори. HMEF 750, HMEF 500 и HMEF Mini могат да бъдат използвани на възрастни и педиатрични пациенти, а HMEF 1000 на възрастни пациенти. HMEF са предназначени за използване само от квалифициран медицински персонал.

Инструкции за употреба

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящите указания. Поставете HMEF между проксималния край на изкуствения въздушен път и тройника на дихателния кръг. Винаги подменяйте HMEF след всеки пациент. Когато се използва продължително на един пациент, сменяйте HMEF на всеки 24 часа или по често според необходимостта.

Противопоказания

HMEF са противопоказани при пациенти, отделящи скоротечни пенести секрети в техните дихателни пътища и дробове.

HMEF не трябва да се използва при пациенти с много малки дихателни обеми, например новородени.

HMEF не трябва да се използва заедно с активни овлажнители или небулизатори.

Предпазни мерки

Всички тръби и свързвания към HMEF трябва да бъдат правилно монтирани и проверени за теч преди употреба. Преди употреба проверете дали HMEF няма запушвания и дали въздухът ще преминава през него.

Може да се наложи компенсация на вентилацията при използването на HMEF, тъй като към системата ще бъде добавено мъртво пространство. По време на употребата на HMEF пациентът трябва да се мониторира внимателно и да се извършват съответните грижи за дихателните пътища, ако възникнат усложнения.

Ако не е свързана тръба за вземане на проби, се уверете, че капачката на порта за вземане на проби на HMEF е правилно фиксирана. HMEF трябва да се сменя за различни пациенти.

Забележка

В опаковката на HMEF може да се появят малки капчици дори когато тя е запечатана. Това е нормално явление и не оказва влияние върху употребата или функционирането на HMEF.

Технически данни	8004231	557070500 557070700 ³⁾	M1004132 M1038639 M1010538 M1005260 ³⁾	M1038637 M1010534 557070100 557071500 ³⁾ 557071600 ³⁾ 557085500 ³⁾ 8570203 ³⁾ 557019500 ³⁾
Минимум VT (ml)	60	120	120	300
Максимум VT (ml)	500	500	750	1000
Мъртъв обем (ml)	21	30	34	77
Тегло (g)	14	15	17	24
Ефективност на филтрация ¹⁾				
- Бактериална (%)	99.999	99.999	99.9999	99.9999
- Вирусна (%)	99.98	99.98	99.998	99.99
Влага към пациента (mg H ₂ O/l) ²⁾	31	31	32	33
Загуба на влага (mg H ₂ O/l)	6.5	6.5	5.5	4.5
- измерено при VT (ml)	250	250	250	500
Влага към пациента (mg H ₂ O/l) ²⁾	27	30	27	30
Загуба на влага (mg H ₂ O/l) ²⁾	10.5	7.5	10.5	7.5
- измерено при VT (ml)	500	500	750	1000
Пад на налягането, kPa (cm H ₂ O) ²⁾	0.14 (1.4)	0.15 (1.5)	0.09 (0.9)	0.10 (1.0)

Všechny hadičky a zkontrolovány: Před použitím zk. vzduchu.

Protože bude při vhodné provést! V průběhu použi problému mu m. Není-li zapojen v krytku na vzorko. Mezi jednotlivými

Poznámka

Uvnitř balení HME. Je to normální a

Technické param

Minimum VT (ml)

Maximum VT (ml)

Mrtvý prostor (ml)

Váha (g)

Účinnost filtrace¹⁾

- Bakteriální (%)

- Virální (%)

Vlhkost k pacientovi (mgH₂O/l)²⁾

Ztráta vlhkosti (mgH₂O/l)

- měřená při VT (r

Vlhkost k pacientovi (mgH₂O/l)²⁾

Ztráta vlhkosti (mgH₂O/l)²⁾

- měřená při VT (r

Pokles tlaku, kPa (cmH₂O)²⁾

- měřená při průt (l/min)

Pokles tlaku, kPa (cmH₂O)²⁾

- měřená při průt (l/min)

1) Měřeno metod

2) Měřeno po pr

3) Informace ohl

přiloženém inř

Životnost: Max.

Varování

Jednorázové vý použití může př a/nebo funkčno výsledek fyzické sterilizace a/n

Informace k

Další informace webu carefusioni

©2016 CareFus

práva vyhrazen

registrované ob

HMEFs

Brugervej

Materiale

Kabinet: Polyp

HME-element:

Filterelement: F

Ikke fremstillet

a) Gassample i

HMEF= Varme

Tilsigtet an

AirLife HMEF i

er kombination

behøver fugtnir

krædskontamin

hospitaler, inte

og sammen me

bruges på vok

HMEFs er kun

breathing circuit.
Always replace the HMEF after each patient.
When used continuously on a single patient, change the HMEF every 24 hours or more frequently as required.

Contraindications

The HMEFs are contraindicated in patients producing fulminating, frothy secretions within their airways and lungs.
The HMEFs shall not be used on patients with very small tidal volumes, for example neonates.
The HMEFs shall not be used together with active humidifiers or nebulizers.

Precautions

All tubing and connections to the HMEF shall be properly attached and checked for leakage prior to use. Before use, verify that the HMEF has no occlusions and that air will flow through it.
Compensation of ventilation may be necessary when using the HMEF since dead space will be added to the system.
During the use of the HMEF, the patient shall be closely monitored and proper airway care administered if complications arise.
If a sampling tube is not connected, make sure that the sampling port cap on the HMEF is properly secured.
The HMEF must be changed between patients.

Note

Droplets may appear inside the HMEF package, even though the package is sealed. This is a normal occurrence and does not affect the use or performance of the HMEF.

Technical data	8004231	557070500 557070700 ³⁾	M1004132 M1038639 M1010538 M1005260 ³⁾	M1038637 M1010534 557070100 557071500 ³⁾ 557071600 ³⁾ 557085500 ³⁾ 8570203 ³⁾ 557019500 ³⁾
Minimum VT (ml)	60	120	120	300
Maximum VT (ml)	500	500	750	1000
Dead space (ml)	21	30	34	77
Weight (g)	14	15	17	24
Filteration efficiency ¹⁾				
- Bacterial (%)	99.999	99.999	99.9999	99.9999
- Viral (%)	99.98	99.98	99.998	99.99
Moisture to patient (mgH ₂ O/l) ²⁾	31	31	32	33
Moisture loss (mgH ₂ O/l)	6.5	6.5	5.5	4.5
- measured at VT (ml)	250	250	250	500
Moisture to patient (mgH ₂ O/l) ²⁾	27	30	27	30
Moisture loss (mgH ₂ O/l) ²⁾	10.5	7.5	10.5	7.5
- measured at VT (ml)	500	500	750	1000
Pressure drop, kPa (cmH ₂ O) ²⁾	0.14 (1.4)	0.15 (1.5)	0.09 (0.9)	0.10 (1.0)
- measured at flow (l/min)	30	30	30	30
Pressure drop, kPa (cmH ₂ O) ²⁾	0.32 (3.2)	0.33 (3.3)	0.22 (2.2)	0.23 (2.3)
- measured at flow (l/min)	60	60	60	60

¹⁾ Measured by the method of Nelson Laboratories Inc., USA. Records on file.
²⁾ Measured after pre-conditioning the product for 24 h (ISO 9360).
³⁾ See additional Information Sheet for Dead space and Weight values.
Shelf life: Max. 3 years. Expiration date printed on the package.

Warning

Single-use products are not designed to be reused. Reuse may cause a risk of cross-contamination, affect the measurement accuracy and/or system performance, or cause a malfunction as a result of the product being physically damaged due to cleaning, disinfection, re-sterilization and/or reuse.

Ordering information

For further information, please contact your local sales representative or visit carefusion.com.

©2016 CareFusion Corporation or one of its affiliates. All rights reserved. CareFusion and the CareFusion logo are trademarks or registered trademarks of CareFusion Corporation or one of its affiliates.

 CareFusion Finland 320 Oy
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki, Finland
+358 20 7871 090



2089351-001 Rev. A 2016-05

Минимум VT (ml)	60	120	120	300
Максимум VT (ml)	500	500	750	1000
Мъртъв обем (ml)	21	30	34	77
Тегло (g)	14	15	17	24
Ефективност на филтрация ¹⁾				
- Бактериална (%)	99.999	99.999	99.9999	99.9999
- Вирусна (%)	99.98	99.98	99.998	99.99
Влага към пациента (mg H ₂ O/l) ²⁾	31	31	32	33
Загуба на влага (mg H ₂ O/l)	6.5	6.5	5.5	4.5
- измерено при VT (ml)	250	250	250	500
Влага към пациента (mg H ₂ O/l) ²⁾	27	30	27	30
Загуба на влага (mg H ₂ O/l) ²⁾	10.5	7.5	10.5	7.5
- измерено при VT (ml)	500	500	750	1000
Пад на налягането, kPa (cm H ₂ O) ²⁾	0.14 (1.4)	0.15 (1.5)	0.09 (0.9)	0.10 (1.0)
- измерено при дебит (l/min)	30	30	30	30
Пад на налягането, kPa (cm H ₂ O) ²⁾	0.32 (3.2)	0.33 (3.3)	0.22 (2.2)	0.23 (2.3)
- измерено при дебит (l/min)	60	60	60	60

¹⁾ Измерено по метода на Nelson Laboratories Inc., САЩ. Записи в архива.
²⁾ Измерено след предварителна аклиматизация на продукта за 24 ч. (ISO 9360).
³⁾ Вижте допълнителния информационен лист за стойностите на мъртвия обем и теглото.
Срок на съхранение: Макс. 3 години. Датата на срока на годност е отпечатана на опаковката.

Предупреждение

Продуктите за еднократна употреба не са предназначени за повторна употреба. Повторната употреба може да причини риск от кръстосано заразяване, може да се отрази на точността на измерването и/или на характеристиките на системата или да причини неизправност в резултат на физическо уреждане на продукта, причинено от почистване, дезинфекциране или повторна стерилизация и/или повторна употреба.

Информация за поръчка

За допълнителна информация се свържете с местния търговски представител или посетете carefusion.com.

©2016 CareFusion Corporation или някой от нейните филиали. Всички права запазени. CareFusion и логото на CareFusion са търговски марки или регистрирани търговски марки на CareFusion Corporation или някой от нейните филиали.

CS

Český jazyk

AirLife™

Jednorázové bakteriální a virální filtry se zvlhčením HMEF

Pokyny k použití

Materiál

Kryt: Polypropylen (PP)
Prvek HME: Polyuretan (PU)
Prvek filtru: Polypropylen/syntetický

Není vyrobeno z přírodního kaučuku (latexu).

a) Konektor pro odvod vzorku plynu

HMEF= Heat and moisture exchanger with integrated bacterial/viral filter (Výměník tepla a vlhkosti s integrovaným bakteriálním a virálním filtrem)

Zamýšlené použití

Výrobky AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 a HMEF 1000 (dále nazývané zkratkou HMEFs) jsou kombinace HME (výměník tepla a vlhkosti) a filtru. HMEF jsou výrobky na jedno použití určené pro pacienty vyžadující zvlhčování ventilačních plynů. Zajišťují filtraci za účelem redukce křížové kontaminace mezi pacientem a přístrojem. HMEF jsou určeny pro použití v nemocnici, JIP, při anestezii, při respirační terapii při transportu a u resuscitačních přístrojů. HMEF 750, HMEF 500 a HMEF Mini mohou být použity u dospělých a pediatrických pacientů a HMEF 1000 u dospělých pacientů. HMEF jsou určeny pouze pro použití kvalifikovaným zdravotnickým personálem.

Pokyny k použití

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Filtry se umísťují buď mezi proximální konec endotracheální kanyly a Y kus, nebo k inspiračnímu/expiračnímu výstupu ventilátoru, nebo anesteziologického přístroje.
HMEF vyměňte vždy po každém pacientovi.
Doporučená frekvence výměny filtrů je po maximálně 24 hodinách nebo dříve pokud je uvnitř zjevná vlhkost.

Kontraindikace

Filtry jsou kontraindikovány u pacientů produkujících v dechových cestách a v plicích větší množství pěnových sekretů.
HMEFs nesmí být používány u pacientů s velmi malými dechovými objemy, například u novorozenců.
HMEFs nesmí být používány společně s aktivními zvlhčovači nebo

Brugervejledning

Materiale

Kabinet: Polypropylen
HME-element: Polyuretan
Filterelement: Polypropylen

Ikke fremstillet med r

a) Gassample udtag

HMEF= Varme og fu

Tilsluttet anvendelse

AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 og HMEF 1000 er kombinationer af HMEF og filterelement, der kræver fugtning i krydskontaminering i hospitaler, intensivafdeling og sammen med respirationssystemet bruges på voksne og HMEFs er kun til brug

Brugervejledning

Læs vejledningen her mellem den proxima i patientkredslobet. Skift altid HMEF ofte Ved kontinuerlig brug nødvendig.

Kontraindikation

HMEF må ikke anvendes i lunger.
HMEF må ikke anvendes på nyfødte.
HMEF må ikke anvendes

Forholdsregler

Før brug kontrolleres tætte. Før brug skal vi strømme igennem Kompensation af HMEF kan være nødvendig Under anvendelse a behandling af luftvej Hvis sampleslange il prøvetagningsstuds HMEF skal skiftes m

Bemærk

Der kan forekomme forsegle. Dette er n

Tekniske data

Minimum VT (ml)

Maximum VT (ml)

Deadspace (ml)

Vægt (g)

Filterings effektivitet¹⁾

- Bakteriell (%)

- Virus (%)

Fugt til patient (mgH₂O/l)²⁾

Fugttab (mgH₂O/l)

- målt ved VT (ml)

Fugt til patient (mgH₂O/l)²⁾

Fugttab (mgH₂O/l)²⁾

- målt ved VT (ml)

Trykfald, kPa (cmH₂O)²⁾

- målt ved gennemstrømning (l/min)

Trykfald, kPa (cmH₂O)²⁾

- målt ved gennemstrømning (l/min)

¹⁾ Målt i henhold til arkiveret.

²⁾ Målt efter at produ

³⁾ Se det supplerende vægtangivelser.

Holdbarhed: Højest 3

Advarsel

Engangstilbehør er i forårsage risiko for t og/eller systempræs produkt er fysisk sk og/eller brug.

Bestillingsoply

Kontakt din lokale s yderligere oplysning

	60	120	120	300
Минимум VT (ml)	500	500	750	1000
Мъртъв обем (ml)	21	30	34	77
Тегло (g)	14	15	17	24
Ефективност на филтрация ¹				
– Бактериална (%)	99.999	99.999	99.9999	99.9999
– Вирусна (%)	99.98	99.98	99.998	99.99
Влага към пациента (mg H ₂ O/l) ²	31	31	32	33
Загуба на влага (mg H ₂ O/l)	6.5	6.5	5.5	4.5
– измерено при VT (ml)	250	250	250	500
Влага към пациента (mg H ₂ O/l) ²	27	30	27	30
Загуба на влага (mg H ₂ O/l) ²	10.5	7.5	10.5	7.5
– измерено при VT (ml)	500	500	750	1000
Пад на налягането, kPa (cm H ₂ O) ²	0.14 (1.4)	0.15 (1.5)	0.09 (0.9)	0.10 (1.0)
– измерено при дебит (l/min)	30	30	30	30
Пад на налягането, kPa (cm H ₂ O) ²	0.32 (3.2)	0.33 (3.3)	0.22 (2.2)	0.23 (2.3)
– измерено при дебит (l/min)	60	60	60	60

¹ Измерено по метода на Nelson Laboratories Inc., САЩ. Записи в архива.

² Измерено след предварителна аклиматизация на продукта за 24 ч. (ISO 9360).

³ Вижте допълнителния информационен лист за стойностите на мъртвия обем и теглото. Срок на съхранение: Макс. 3 години. Датата на срока на годност е отпечатана на опаковката.

37
34
00
:00³
:00³
:00³
:00³

Предупреждение

Продуктите за еднократна употреба не са предназначени за повторна употреба. Повторната употреба може да причини риск от кръстосано заразяване, може да се отрази на точността на измерването и/или на характеристиките на системата или да причини неизправност в резултат на физическо увреждане на продукта, причинено от почистване, дезинфекциране или повторна стерилизация и/или повторна употреба.

Информация за поръчка

За допълнителна информация се свържете с местния търговски представител или посетете carefusion.com.

©2016 CareFusion Corporation или някой от нейните филиали. Всички права запазени. CareFusion и логото на CareFusion са търговски марки или регистрирани търговски марки на CareFusion Corporation или някой от нейните филиали.



Jednorázové bakteriální a virální filtry se zvlhčením HMEF

Pokyny k použití

Материál

Крыт: Polypropylen (PP)
Првек HME: Polyuretan (PU)
Првек филтру: Polypropylen/syntetický

Не е изработено от природно каучуко (latexu).

a) Konektor pro odvod vzorku plynu

HMEF= Heat and moisture exchanger with integrated bacterial/viral filter (Вýměník tepla a vlhkosti s integrovaným bakteriálním a virálním filtrem)

Zamýšlené použití

Вýrobky AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 a HMEF 1000 (дále nazývané zkratkou HMEFs) jsou kombinace HME (výměník tepla a vlhkosti) a filtru. HMEF jsou výrobky na jedno použití určené pro pacienty vyžadující zvlhčování ventilačních plynů. Zajišťují filtraci za účelem redukce křížové kontaminace mezi pacientem a přístrojem. HMEF jsou určeny pro použití v nemocnici, JIP, při anestezii, při respirační terapii při transportu a u resuscitačních přístrojů. HMEF 750, HMEF 500 a HMEF Mini mohou být použity u dospělých a pediatrických pacientů a HMEF 1000 u dospělých pacientů. HMEF jsou určeny pouze pro použití kvalifikovaným zdravotnickým personálem.

Pokyny k použití

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete tento návod. Filtry se umísťují buď mezi proximální konec endotracheální kanyly a Y kus, nebo k inspiračnímu/expiračnímu výstupu ventilátoru, nebo anesteziologického přístroje. HMEF vyměříte vždy po každém pacientovi. Doporučená frekvence výměny filtrů je po maximálně 24 hodinách nebo dříve pokud je uvnitř zjevná vlhkost.

Kontraindikace

Filtry jsou kontraindikovány u pacientů produkujících v dechových cestách a v plicích větší množství pěnových sekretů. HMEFs nesmí být používány u pacientů s velmi malými dechovými objemy, například u novorozenců. HMEFs nesmí být používány společně s aktivními zvlhčovači nebo nebulizátory.

Brugervejledning

Materiale

Kabinet: Polypropylen (PP)
HME-element: Polyurethan (PU)
Filterelement: Polypropylen/syntetisk

Ikke fremstillet med naturlig latexgummi.

a) Gassample udtag

HMEF= Varme og fugt udveksler med integreret bakteriel/viral filter.

Tilsigtet anvendelse

AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 og HMEF 1000 (herefter HMEF) er kombinationer af HME/Filter. HMEF er til engangsbrug for patienter der behøver fugtning under ventiler med gasser. De reducerer muligheden for krydskontaminering mellem patienter og udstyr. HMEFs er til brug for hospitaler, intensivafdel., anæstesi, behandling af lungesygge, under transport og sammen med resuscitators. HMEF 750, HMEF 500 og HMEF Mini kan bruges på voksen og børnepatienter og HMEF 1000 på voksen patienter. HMEFs er kun til brug for kvalificeret, medicinsk personale.

Brugervejledning

Læs vejledningen helt igennem, før produktet tages i brug. Anbring HMEF mellem den proximale ende af den kunstige luftvej og Y-stykket i patientkredsløbet.

Skift altid HMEF efter hver patient.

Ved kontinuerlig brug, skal HMEF skiftes hver 24 time, eller oftere om nødvendigt.

Kontraindikationer

HMEF må ikke anvendes til patienter med kraftig sekretudsondring i luftvej og lunger.

HMEF må ikke anvendes til patienter med meget lille åndedrætsdybde, f.eks. nyfødte.

HMEF må ikke anvendes sammen med aktive fugtere eller nebulizere.

Forholdsregler

Før brug kontrolleres det, at alle slanger og koblinger til HMEF er faste og tætte. Før brug skal verificeres at filteret ikke har nogen tilstopninger og at luft vil strømme igennem det.

Kompensation for deadspace, der tilføjes systemet ved anvendelse af HMEF, kan være nødvendig.

Under anvendelse af HMEF skal patienten overvåges nøje, og korrekt behandling af luftvejene igangsættes, hvis der opstår komplikationer.

Hvis sampleslange ikke er tilsluttet, sikres det, at hæften til prøvetagningsstudsens på HMEF er korrekt fastspændt. HMEF skal skiftes mellem hver patient.

Bemærk

Der kan forekomme dråbedannelser i HMEF pakningen, selv om denne er forsejlet. Dette er normalt og påvirker ikke brug eller ydeevne af HMEF.

Tekniske data	8004231	557070500 557070700 ³	M1004132 M1038639 M1010538 M1005260 ³	M1038637 M1010534 557070100 557071500 ³ 557071600 ³ 557085500 ³ 8570203 ³ 557019500 ³
Minimum VT (ml)	60	120	120	300
Maximum VT (ml)	500	500	750	1000
Deadspace (ml)	21	30	34	77
Vægt (g)	14	15	17	24
Filteringseffektivitet ¹				
– Bakteriel (%)	99.999	99.999	99.9999	99.9999
– Virus (%)	99.98	99.98	99.998	99.99
Fugt til patient (mgH ₂ O/l) ²	31	31	32	33
Fugttab (mgH ₂ O/l)	6.5	6.5	5.5	4.5
– målt ved VT (ml)	250	250	250	500
Fugt til patient (mgH ₂ O/l) ²	27	30	27	30
Fugttab (mgH ₂ O/l) ²	10.5	7.5	10.5	7.5
– målt ved VT (ml)	500	500	750	1000
Trykfald, kPa (cmH ₂ O) ²	0.14 (1.4)	0.15 (1.5)	0.09 (0.9)	0.10 (1.0)
– målt ved gennemstrømning (l/min)	30	30	30	30
Trykfald, kPa (cmH ₂ O) ²	0.32 (3.2)	0.33 (3.3)	0.22 (2.2)	0.23 (2.3)
– målt ved gennemstrømning (l/min)	60	60	60	60

¹ Målt i henhold til målemetode ved Nelson Laboratories Inc., USA. Protokoll arkiveret.

² Målt efter at produktet havde været i brug i 24 timer (ISO 9360).

³ Se det supplerende oplysningsark for at få angivet dead space og vægtangivelser.

Holdbarhed: Højest 3 år. Udløbsdato er påtrykt emballagen.

Advarsel

Engangstilbehør er ikke beregnet til at blive genanvendt. Genanvendelse kan forårsage risiko for kryds-kontaminering, påvirke nøjagtighed af målinger og/eller systempræstation eller forårsage fejlfunktion som et resultat af, at et produkt er fysisk skadet som følge af rensning, desinficering, re-sterilisering og/eller brug.

Bestillingsoplysninger

Kontakt din lokale salgsrepræsentant, eller besøg carefusion.com, for yderligere oplysninger.

HMEFs, engangs

Bruksanvisning

Materiale

Hus: polypropylen (PP)
HME-element: polyuretan (PU)
Filterelement: polypropylen/syntetisk

Ikke fremstilt med naturlig gummitateks.

— a) Uttak for testgass

HMEF= Fukte-og varmeveksler med integrert bakterie-/virusfilter

Tiltenkt bruk

AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 og HMEF 1000 (heretter referert til som HMEF) er HME-filter kombinasjoner. HMEFs er engangsutstyr indikert for pasienter som krever fuktig i forbindelse med ventilatorbehandling. De filtrerer gassen for å redusere mulig krysskontaminasjon mellom pasienter og utstyr. HMEF's er for bruk på sykehus, intensivavdelinger, anestesivdelinger, ved respiratorbehandling, under transport og med resuscitatorer. HMEF 750, HMEF 500 og HMEF Mini kan brukes på både voksne og pediatriske pasienter, og HMEF 1000 på voksne pasienter. HMEFs er tiltenkt brukt kun av kvalifisert medisinsk personell.

Bruksanvisning

Les disse instruksjonene nøye før produktet tas i bruk. Plasser HMEFs mellom den proksimale enden av luftveisslangene og Y-stykket på pasientkretsen.

Bytt alltid HMEF etter hver pasient.

Ved kontinuerlig bruk på en pasient byttes HMEF hver 24. time eller oftere hvis nødvendig.

Kontraindikasjoner

HMEFs er kontraindisert til pasienter med fulminant, skummende sekresjon fra sine lunger og luftveier.

HMEFs skal ikke brukes til pasienter med meget små tidalvolum, f.eks. neonatale.

HMEFs skal ikke benyttes sammen med aktive fukttere eller forstøvere.

Forholdsregler

Alle slanger og tilkoblinger til HMEF skal fikseres godt og kontrolleres for lekkasje før bruk. Før bruk, kontroller at filteret ikke har blokkeringer og at luft kan passere gjennom det.

Kompensering av ventilasjonen kan være nødvendig ved bruk av HMEF, da dødrømmet i systemet vil øke.

Ved bruk av HMEF skal pasienten overvåkes nøye, og riktig behandling av luftveiene kunne iverksettes hvis det oppstår komplikasjoner.

Hvis testgasslange ikke er tilkoblet, kontroller at lukkeproppen er godt festet til uttaket for testgassen på HMEF.

HMEF må skiftes mellom hver pasient.

Bemerk

Små dråper kan oppstå på innsiden av HMEF forpakningen, selv om forpakningen er tett. Dette er en normal forekomst, og som ikke påvirker bruk eller ytelse av HMEF.

Tekniske data	8004231	557070500 557070700 ³⁾	M1004132 M1038639 M1010538 M1005260 ³⁾	M1038637 M1010534 557070100 557071500 ³⁾ 557071600 ³⁾ 557085500 ³⁾ 8570203 ³⁾ 557019500 ³⁾
Minimum TV (ml)	60	120	120	300
Maximum TV (ml)	500	500	750	1000
Dødrøm (ml)	21	30	34	77
Vekt (g)	14	15	17	24
Filteringsevne ¹				
- Bakterier (%)	99.999	99.999	99.9999	99.9999
- Virus (%)	99.98	99.98	99.998	99.99
Fuktighet til pasient (mg H ₂ O/l) ²	31	31	32	33
Fuktighetstap (mg H ₂ O/l)	6.5	6.5	5.5	4.5
- målt ved TV (ml)	250	250	250	500
Fuktighet til pasient (mg H ₂ O/l) ²	27	30	27	30
Fuktighetstap (mg H ₂ O/l) ²	10.5	7.5	10.5	7.5
- målt ved TV (ml)	500	500	750	1000
Trykkfall, kPa (cm H ₂ O) ²	0.14 (1.4)	0.15 (1.5)	0.09 (0.9)	0.10 (1.0)
- målt ved flow (l/min)	30	30	30	30
Trykkfall, kPa (cm H ₂ O) ²	0.32 (3.2)	0.33 (3.3)	0.22 (2.2)	0.23 (2.3)
- målt ved flow (l/min)	60	60	60	60

¹⁾ Målt med en metode fra Nelson Laboratories Inc., USA. Protokoll tilgjengelig.

²⁾ Målt etter forbehandling og kondisjonering av produktet i 24 timer (ISO 9360).

³⁾ Se informasjonsarket om dødrøms- og vektverdier. Lagringstid: Maks. 3 år. Utløpsdato står på esken.

Advarsel

Engangsprodukter er ikke ment å brukes på nytt. Gjenbruk kan føre til risiko



AirLife™

Suomi

HMEF, kertakäyttöinen

Käyttöohjeet

Materiaali

Kotelo: Polypropeeni (PP)
HME-elementti: Polyuretaani (PU)
Suodatinelementti: Polypropeeni/synteettinen

Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.

a) Kaasunäytteenottoiliin

HMEF= lämmön ja kosteuden vaihdin sisältäen bakteeri-/virussuodattimen

Käyttötarkoitus

AirLifen HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 ja HMEF 1000 (kaikkiin viitataan myöhemmin nimellä HMEF) ovat lämmön- ja kosteudenvaihtimen (HME) sekä suodattimen (F) yhdistelmiä. Kertakäyttöistä HMEF:ää käytetään potilailla, joiden sisäänhengityskaasua halutaan kostuttaa. Suodatin estää mahdollisen kontaminaation potilaan ja laitteiston välillä. HMEF:ää käytetään sairaalaympäristössä, tehohoidossa, anestesian aikana, hengityksen tukihoidossa, potilaan kuljetuksessa ja hengityspalkeen kanssa. HMEF 750, HMEF 500 ja HMEF Mini on tarkoitettu aikuisille ja lapsille, HMEF 1000 vain aikuispotilaille. HMEF on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilökunnan käyttöön.

Käyttöohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Sijoita HMEF intubaatio-/trakeostomiaputken ja hengityskierroon Y-kappaleen väliin. HMEF on aina vaihdettava potilaiden välillä. HMEF on vaihdettava 24 tunnin välein tai tarvittaessa useammin.

Kontraindikaatiot

HMEF:ää ei saa käyttää potilailla, joilla on runsasta erityistä hengitysteistä ja keuhkoista.

HMEF:ää ei saa käyttää potilailla, joiden kertahengitystilavuus on erittäin pieni, kuten vastasyntyneillä.

HMEF:n kanssa ei saa käyttää aktiivisia kostuttimia eikä lääkesumutinta.

Huomioon otettavaa

Kaikki HMEF:n liittämät on kiinnitettävä huolellisesti ja tarkistettava vuotojen varalta ennen käyttöä. Varmista ennen käyttöä, että HMEF:ssä ei ole tukoksia ja että ilma virtaa sen läpi.

Ventilaattorin asetuksissa tulee ottaa huomioon HMEF:n lisäämä kuollut tila. HMEF:n käytön aikana potilaan on oltava huolellisessa tarkkailussa, ja hengitysteiden kunnosta on huolehdittava mahdollisissa komplikaatio-tilanteissa.

Jos näytteenottoletkua ei ole liitetty, varmista, että HMEF:n näytteenotto liittimen korkki on tiukasti kiinni.

HMEF on vaihdettava potilaiden välillä.

Huom.

Pieniä pisaroita voi esiintyä HMEF pakkauksen sisällä, vaikka pakkaus on avaamaton. Tämä on normaalia eikä vaikuta HMEF:n käyttöön tai suorituskykyyn.

Tekniset tiedot

	8004231	557070500 557070700 ³⁾	M1004132 M1038639 M1010538 M1005260 ³⁾	M1038637 M1010534 557070100 557071500 ³⁾ 557071600 ³⁾ 557085500 ³⁾ 8570203 ³⁾ 557019500 ³⁾	
25	Minimitilavuus VT (ml)	60	120	120	300
27	Maksimitilavuus VT (ml)	500	500	750	1000
11	Kuollut tila (ml)	21	30	34	77
51	Paino (g)	14	15	17	24
0	Suodatusteho ¹⁾				
3	- Bakteerit (%)	99.999	99.999	99.9999	99.9999
0	- Virukset (%)	99.98	99.98	99.998	99.99
0	Kosteus potilaaseen (mgH ₂ O/l) ²⁾	31	31	32	33
0	Kosteushäviö (mgH ₂ O/l)	6.5	6.5	5.5	4.5
0	- mitattuna VT (ml)	250	250	250	500
0	Kosteus potilaaseen (mgH ₂ O/l) ²⁾	27	30	27	30
0	Kosteushäviö (mgH ₂ O/l) ²⁾	10.5	7.5	10.5	7.5
0	- mitattuna VT (ml)	500	500	750	1000

Minsi
Störs
Dead
Vikt
Filtre
- Bal
- Vin
Fukt t
H₂O/l
Fuktf
- upp
Fukt t
H₂O/l
Fuktf
- upp
Tryck
- upp
(l/min)
Tryck
- upp
(l/min)
¹⁾ Up,
arkiv
²⁾ Up,
³⁾ Me
Hällb
Van
Prod
kan f
syste
skad:
Bes
För y
eller
©201
Saml
är va
Corp



Kul

Mat
Muhe
HME
Filtre

Doğa

a) Ga

HMEI

Kull
AirLif
HMEI
ler ve
hasta
ile ek
filtras
hasta
kullar
hasta
HMEI

Kull
Ürünt
havağ
yerleş
Her b
Tek b
bir ya

Painehäviö, kPa (cmH ₂ O) ²	0.14 (1.4)	0.15 (1.5)	0.09 (0.9)	0.10 (1.0)
- virtauksella (l/min)	30	30	30	30
Painehäviö, kPa (cmH ₂ O)	0.32 (3.2)	0.33 (3.3)	0.22 (2.2)	0.23 (2.3)
- virtauksella (l/min)	60	60	60	60

- ¹⁾ Mitattu Nelson Laboratories Inc:n, USA, menetelmällä. Tiedot arkistoitu.
²⁾ Mitattu tuotteella, jota on esikäytetty 24 h (ISO 9360).
³⁾ Tietoja kuolleen tilan ja painon arvoista on lisätietolomakkeessa.
 Säilytysaika: Enintään 3 vuotta. Viimeinen käyttöpäivä on painettu pakkaukseen.

Vakava varoitus

Kertakäyttöisiä tuotteita ei saa käyttää uudelleen. Uudelleenkäyttö voi aiheuttaa tartuntavaaran, vaikuttaa mittaustulosten tarkkuuteen ja/tai järjestelmän suorituskykyyn tai aiheuttaa toimintahäiriön, jos tuote vaurioituu puhdistuksen, desinfiointin, uudelleensteriloinnin ja/tai uudelleenkäytön yhteydessä.

Tilautustiedot

Lisätietoja saat ottamalla yhteyden paikalliseen myyntiedustajaan tai käymällä osoitteessa carefusion.com.

©2016 CareFusion Corporation tai jokin sen tytäryhtiöistä. Kaikki oikeudet pidätetään. CareFusion ja CareFusionin logo ovat CareFusion Corporationin tai jonkin sen tytäryhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SV

Svenska

AirLife™

HMEFs, för engångsbruk

Bruksanvisning

Material

Hölje: Polypropylen (PP)
 HME-element: Polyuretan (PU)
 Filterelement: Polypropylen/syntetiskt

Ej tillverkad med naturligt latexgummi.

a) Anslutning för gassampling

HMEF = fukt/värmeväxare med integrerat bakterie och virusfilter

Avsedd användning

AirLifes HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 och HMEF 1000 (nedan kallade HMEFs) är HME/Filter kombinationer. HMEFs engångs produkt för patienter som kräver andfuktning vid ventilatorbehandling. De åstadkommer för att minska contamination mellan patient och utrustning. HMEFs används på sjukhus inom IVA, anestesi, andningsterapi under transporter och vid manuell ventilation med blåsa. HMEF 750, HMEF 500 och HMEF Mini kan användas på vuxna patienter och barn och HMEF 1000 är till för vuxna patienter. HMEF produkterna ska endast användas av kvalificerad personal.

Bruksanvisning

Läs instruktionerna noggrant innan ni börjar använda produkten. Ansluta HMEF i andningskretsen mellan endotrakeal/trakeostomituben och Y stycket. Byt HMEF alltid mellan varje patient. När de används på en patient, skall HMEF bytas ut var 24:e timme eller oftare om så behövs.

Kontraindikationer

HMEF skall inte användas på patienter med kraftig sekretutsöndring i luftvägar och lungor.
 HMEF skall inte användas på patienter med mycket små tidalvolym, t ex nyfödda eller väldigt små barn.
 HMEFs skall inte användas tillsammans med aktiva befuktare eller vid nebulisering.

Försiktighetsåtgärder

Alla slangar och anslutningar till HMEF skall kontrolleras noggrant före användandet så att de sitter fast ordentligt och att det inte läcker. Före användningen, kontrollera att det inte är stopp i filtret och att luft kan passera genom filtret.
 Vid inställning av ventilator skall hänsyn tas till att HMEF tillför dead space till andningssystemet.
 Vid användning av HMEF skall patienten vara noggrant övervakad och korrekt behandling av luftvägarna skall vidtas om komplikationer uppstår. Om samplings slang ej används, kontrollera att hatten på samplingsporten på HMEF är ordentligt påskruvad.
 HMEF måste bytas mellan olika patienter.

OBS!

Små droppar kan visa sig inuti HMEF förpackning även om förpackningen är försluten. Detta kan vara normalt och påverkar inte effekten och användningen av HMEF.

Tekniska data	8004231	557070500	M1004132	M1038637
		557070700 ³⁾	M1038639	M1010534
			M1010538	557070100
			M1005260 ³⁾	557071500 ³⁾

©2016 CareFusion Corporation

HMEFs, för engångsbruk

Bruksanvisning

Material

Hölje: Polypropylen (PP)
HME-element: Polyuretan (PU)
Filterelement: Polypropylen/syntetiskt
Ej tillverkad med naturligt latexgummi.

a) Anslutning för gassampling

HMEF = fukt/värmeväxlare med integrerat bakterie och virusfilter

Avsedd användning

AirLifes HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 och HMEF 1000 (nedan kallade HMEFs) är HME/Filter kombinationer. HMEFs engångs produkt för patienter som kräver andfuktning vid ventilatorbehandling. De åstadkommer för att minska contamination mellan patient och utrustning. HMEFs används på sjukhus inom IVA, anestesi, andningsterapi under transporter och vid manuell ventilation med blåsa. HMEF 750, HMEF 500 och HMEF Mini kan användas på vuxna patienter och barn och HMEF 1000 är till för vuxna patienter. HMEF produkterna ska endast användas av kvalificerad personal.

Bruksanvisning

Läs instruktionerna noggrant innan ni börjar använda produkten. Ansluta HMEF i andningskretsen mellan endotrakeal/trakeostomituben och Y stycket. Byt HMEF alltid mellan varje patient. När de används på en patient, skall HMEF bytas ut var 24:e timme eller oftare om så behövs.

Kontraindikationer

HMEF skall inte användas på patienter med kraftig sekretutsöndring i luftvägar och lungor.
HMEF skall inte användas på patienter med mycket små tidalvolym, t ex nyfödda eller väldigt små barn.
HMEFs skall inte användas tillsammans med aktiva befuktare eller vid nebulisering.

Försiktighetsåtgärder

Alla slangar och anslutningar till HMEF skall kontrolleras noggrant före användandet så att de sitter fast ordentligt och att det inte läcker. Före användningen, kontrollera att det inte är stopp i filtret och att luft kan passera genom filtret.
Vid inställning av ventilator skall hänsyn tas till att HMEF tillför dead space till andningssystemet.

Vid användning av HMEF skall patienten vara noggrant övervakad och korrekt behandling av luftvägarna skall vidtas om komplikationer uppstår. Om samplings slang ej används, kontrollera att hatten på samplingsporten på HMEF är ordentligt påskruvad.
HMEF måste bytas mellan olika patienter.

OBS!

Små droppar kan visa sig inuti HMEF förpackning även om förpackningen är försluten. Detta kan vara normalt och påverkar inte effekten och användningen av HMEF.

Tekniska data	8004231	557070500 557070700 ³⁾	M1004132 M1038639 M1010538 M1005250 ³⁾	M1038637 M1010534 557070100 557021500 ³⁾ 557071600 ³⁾ 557085500 ³⁾ 8570203 ³⁾ 557019500 ³⁾
Minsta tidalvolym (ml)	60	120	120	300
Största tidalvolym (ml)	500	500	750	1000
Dead space (ml)	21	30	34	77
Vikt (g)	14	15	17	24
Filteringseffektivitet ¹⁾				
- Bakterier (%)	99.999	99.999	99.9999	99.9999
- Virus (%)	99.98	99.98	99.998	99.99
Fukt till patient (mg H ₂ O/l) ²⁾	31	31	32	33
Fuktförlust (mg H ₂ O/l)	6.5	6.5	5.5	4.5
- uppmätt vid V _T (ml)	250	250	250	500
Fukt till patient (mg H ₂ O/l) ²⁾	27	30	27	30
Fuktförlust (mg H ₂ O/l) ²⁾	10.5	7.5	10.5	7.5
- uppmätt vid V _T (ml)	500	500	750	1000
Tryckfall, kPa (cmH ₂ O) ²⁾	0.14 (1.4)	0.15 (1.5)	0.09 (0.9)	0.10 (1.0)
- uppmätt vid flöde (l/min)	30	30	30	30
Tryckfall, kPa (cmH ₂ O) ²⁾	0.32 (3.2)	0.33 (3.3)	0.22 (2.2)	0.23 (2.3)
- uppmätt vid flöde (l/min)	60	60	60	60

¹⁾ Uppmätt enligt en mätmetod vid Nelson Laboratories Inc., U.S.A. Protokoll arkiverat.

²⁾ Uppmätt efter att produkten varit i bruk 24 timmar (ISO 9360).

³⁾ Mer information finns i informationsbladet för dead space och viktvärden. Hållbarhetstid: Maximalt 3 år. Utgångsdatum tryckt på förpackningen.

Varning

Produkter för engångsbruk är inte avsedda att återanvändas. Återanvändning kan förorsaka smittspridning, påverka mätningens noggrannhet och/eller systemrestanda eller felfunktion som ett resultat av att produkten har

English	bg	Български	Dansk
---------	-----------	-----------	-------

AirLife™
Филтри, за еднократна употреба

Filters, disposable with and without sampling port
Instructions for Use

<p>REF 557021200 M1003346 557022500 M1010541 M1003345</p> <p>REF Catalogue Number</p> <p>LOT Lot Number</p> <p>X Quantity</p> <p>Manufacturer</p>	<p>AirLife™ Uni-Filtr, Disposable</p> <p>AirLife™ Uni-Filtr Junior, Disposable</p> <p>AirLife™ Uni-Filters, Disposable</p> <p>AirLife™ Angled Uni-Filters, Disposable</p> <p>AirLife™ Mini-Filters, Disposable</p> <p>AirLife™ Angled Mini-Filters, Disposable</p> <p>Caution</p> <p>Consult Instructions for Use</p> <p>For Single Use Only</p> <p>Exp. Date</p> <p>U.S. Federal law restricts this device to use by or on the order of a physician.</p>
<p>Intended use</p> <p>Filters can be used to provide filtration for reducing possible cross contamination between patients and equipment. Filters are for use in the hospital, ICU, anesthesia, respiratory therapy, during transport and with respirators for filtering particles including bacteria, viruses and dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.</p>	
<p>Material</p> <p>PP Polipropylene</p> <p>Not made with natural rubber latex.</p>	
<p>557021200</p> <p>557022500</p> <p>557023000</p> <p>557023000</p> <p>557023000</p>	<p>M1003346</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p>

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

<p>557021200</p> <p>557022500</p> <p>557023000</p> <p>557023000</p> <p>557023000</p>	<p>M1003346</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p>
<p>Instructions for use</p> <p>Read these instructions carefully before using the product. The Filter shall be placed either between the proximal end of the artificial airway and the Y-piece of the breathing circuit or connected to the inspiratory/expiratory port of the ventilator or anesthesia system. The recommended frequency for changing the Filter is a maximum of 24 hours of use or sooner if there is evidence of humidity inside it.</p> <p>Contraindications The Filters are contraindicated in patients producing fluminant, frothy secretions within their airways and lungs. When a Filter is used in the exhalation limb in conjunction with a water bath humidifier, a water trap should be placed between the Filter and the patient. Never position any Filter in the inspiratory limb downstream of a water bath humidifier. Do not use the Filter between the patient and any source of nebulized drugs. When nebulized drugs are administered, breathing resistance should be monitored and the Filter should be replaced following standard hospital procedure.</p> <p>Precautions All tubing and connections to the Filter shall be properly attached and checked for leakage prior to use. Before use, verify that the Filter has no occlusions and that air will flow through it. Compensation of ventilation may be necessary when using the Filter as close to the patient since dead space will be added to the system. If a sampling tube is not connected, make sure that the sampling port cap on the Filter with sampling port is properly secured. The Filter with sampling port should be closely monitored and proper always care administered if complications arise.</p> <p>Warnings Single-use products are not designed to be reused. Reuse may cause a risk of cross-contamination, affect the measurement accuracy and/or system performance, or cause a malfunction or failure of the product being physically damaged due to cleaning, disinfection, re-sterilization and/or reuse.</p>	
<p>Technical data</p> <p>Filtration efficiency</p> <p>- Bacterial (%)</p> <p>- Viral (%)</p> <p>Dead space (ml)</p> <p>Weight (g)</p> <p>Pressure drop kPa (cm H2O)</p> <p>- at 30 l/min</p> <p>- at 60 l/min</p>	<p>557021200</p> <p>M1003346</p> <p>557022500</p> <p>55702300*</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p> <p>-99,98</p> <p>>99,99999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>60</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>22</p> <p>0,4</p> <p>0,8</p> <p>0,7</p> <p>0,7</p> <p>0,14</p> <p>0,8</p> <p>0,22</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p> <p>0,2</p> <p>0,1</p> <p>0,8</p> <p>0,2</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p>
<p>*Mean values. Measured by Nelson Laboratories Inc., USA. Records on file. **See additional Information Sheet for Dead space.</p>	
<p>Technical data</p> <p>Filtration efficiency</p> <p>- Bacterial (%)</p> <p>- Viral (%)</p> <p>Dead space (ml)</p> <p>Weight (g)</p> <p>Pressure drop kPa (cm H2O)</p> <p>- at 30 l/min</p> <p>- at 60 l/min</p>	<p>557022500</p> <p>M1003346</p> <p>557023000</p> <p>55702300*</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p> <p>-99,98</p> <p>>99,99999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>60</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>22</p> <p>0,4</p> <p>0,8</p> <p>0,7</p> <p>0,7</p> <p>0,14</p> <p>0,8</p> <p>0,22</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p> <p>0,2</p> <p>0,1</p> <p>0,8</p> <p>0,2</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p>
<p>*Mean values. Measured by Nelson Laboratories Inc., USA. Records on file. **See additional Information Sheet for Dead space.</p>	
<p>Technical data</p> <p>Filtration efficiency</p> <p>- Bacterial (%)</p> <p>- Viral (%)</p> <p>Dead space (ml)</p> <p>Weight (g)</p> <p>Pressure drop kPa (cm H2O)</p> <p>- at 30 l/min</p> <p>- at 60 l/min</p>	<p>557023000</p> <p>M1003346</p> <p>557022500</p> <p>55702300*</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p> <p>-99,98</p> <p>>99,99999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>60</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>22</p> <p>0,4</p> <p>0,8</p> <p>0,7</p> <p>0,7</p> <p>0,14</p> <p>0,8</p> <p>0,22</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p> <p>0,2</p> <p>0,1</p> <p>0,8</p> <p>0,2</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p>
<p>*Mean values. Measured by Nelson Laboratories Inc., USA. Records on file. **See additional Information Sheet for Dead space.</p>	

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

<p>557021200</p> <p>557022500</p> <p>557023000</p> <p>557023000</p> <p>557023000</p>	<p>M1003346</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p>
<p>Instructions for use</p> <p>Read these instructions carefully before using the product. The Filter shall be placed either between the proximal end of the artificial airway and the Y-piece of the breathing circuit or connected to the inspiratory/expiratory port of the ventilator or anesthesia system. The recommended frequency for changing the Filter is a maximum of 24 hours of use or sooner if there is evidence of humidity inside it.</p> <p>Contraindications The Filters are contraindicated in patients producing fluminant, frothy secretions within their airways and lungs. When a Filter is used in the exhalation limb in conjunction with a water bath humidifier, a water trap should be placed between the Filter and the patient. Never position any Filter in the inspiratory limb downstream of a water bath humidifier. Do not use the Filter between the patient and any source of nebulized drugs. When nebulized drugs are administered, breathing resistance should be monitored and the Filter should be replaced following standard hospital procedure.</p> <p>Precautions All tubing and connections to the Filter shall be properly attached and checked for leakage prior to use. Before use, verify that the Filter has no occlusions and that air will flow through it. Compensation of ventilation may be necessary when using the Filter as close to the patient since dead space will be added to the system. If a sampling tube is not connected, make sure that the sampling port cap on the Filter with sampling port is properly secured. The Filter with sampling port should be closely monitored and proper always care administered if complications arise.</p> <p>Warnings Single-use products are not designed to be reused. Reuse may cause a risk of cross-contamination, affect the measurement accuracy and/or system performance, or cause a malfunction or failure of the product being physically damaged due to cleaning, disinfection, re-sterilization and/or reuse.</p>	
<p>Technical data</p> <p>Filtration efficiency</p> <p>- Bacterial (%)</p> <p>- Viral (%)</p> <p>Dead space (ml)</p> <p>Weight (g)</p> <p>Pressure drop kPa (cm H2O)</p> <p>- at 30 l/min</p> <p>- at 60 l/min</p>	<p>557021200</p> <p>M1003346</p> <p>557022500</p> <p>55702300*</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p> <p>-99,98</p> <p>>99,99999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>60</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>22</p> <p>0,4</p> <p>0,8</p> <p>0,7</p> <p>0,7</p> <p>0,14</p> <p>0,8</p> <p>0,22</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p> <p>0,2</p> <p>0,1</p> <p>0,8</p> <p>0,2</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p>
<p>*Mean values. Measured by Nelson Laboratories Inc., USA. Records on file. **See additional Information Sheet for Dead space.</p>	
<p>Technical data</p> <p>Filtration efficiency</p> <p>- Bacterial (%)</p> <p>- Viral (%)</p> <p>Dead space (ml)</p> <p>Weight (g)</p> <p>Pressure drop kPa (cm H2O)</p> <p>- at 30 l/min</p> <p>- at 60 l/min</p>	<p>557022500</p> <p>M1003346</p> <p>557023000</p> <p>55702300*</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p> <p>-99,98</p> <p>>99,99999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>60</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>22</p> <p>0,4</p> <p>0,8</p> <p>0,7</p> <p>0,7</p> <p>0,14</p> <p>0,8</p> <p>0,22</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p> <p>0,2</p> <p>0,1</p> <p>0,8</p> <p>0,2</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p>
<p>*Mean values. Measured by Nelson Laboratories Inc., USA. Records on file. **See additional Information Sheet for Dead space.</p>	
<p>Technical data</p> <p>Filtration efficiency</p> <p>- Bacterial (%)</p> <p>- Viral (%)</p> <p>Dead space (ml)</p> <p>Weight (g)</p> <p>Pressure drop kPa (cm H2O)</p> <p>- at 30 l/min</p> <p>- at 60 l/min</p>	<p>557023000</p> <p>M1003346</p> <p>557022500</p> <p>55702300*</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p> <p>-99,98</p> <p>>99,99999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>60</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>22</p> <p>0,4</p> <p>0,8</p> <p>0,7</p> <p>0,7</p> <p>0,14</p> <p>0,8</p> <p>0,22</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p> <p>0,2</p> <p>0,1</p> <p>0,8</p> <p>0,2</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p>
<p>*Mean values. Measured by Nelson Laboratories Inc., USA. Records on file. **See additional Information Sheet for Dead space.</p>	

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

<p>557021200</p> <p>557022500</p> <p>557023000</p> <p>557023000</p> <p>557023000</p>	<p>M1003346</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p>
<p>Instructions for use</p> <p>Read these instructions carefully before using the product. The Filter shall be placed either between the proximal end of the artificial airway and the Y-piece of the breathing circuit or connected to the inspiratory/expiratory port of the ventilator or anesthesia system. The recommended frequency for changing the Filter is a maximum of 24 hours of use or sooner if there is evidence of humidity inside it.</p> <p>Contraindications The Filters are contraindicated in patients producing fluminant, frothy secretions within their airways and lungs. When a Filter is used in the exhalation limb in conjunction with a water bath humidifier, a water trap should be placed between the Filter and the patient. Never position any Filter in the inspiratory limb downstream of a water bath humidifier. Do not use the Filter between the patient and any source of nebulized drugs. When nebulized drugs are administered, breathing resistance should be monitored and the Filter should be replaced following standard hospital procedure.</p> <p>Precautions All tubing and connections to the Filter shall be properly attached and checked for leakage prior to use. Before use, verify that the Filter has no occlusions and that air will flow through it. Compensation of ventilation may be necessary when using the Filter as close to the patient since dead space will be added to the system. If a sampling tube is not connected, make sure that the sampling port cap on the Filter with sampling port is properly secured. The Filter with sampling port should be closely monitored and proper always care administered if complications arise.</p> <p>Warnings Single-use products are not designed to be reused. Reuse may cause a risk of cross-contamination, affect the measurement accuracy and/or system performance, or cause a malfunction or failure of the product being physically damaged due to cleaning, disinfection, re-sterilization and/or reuse.</p>	
<p>Technical data</p> <p>Filtration efficiency</p> <p>- Bacterial (%)</p> <p>- Viral (%)</p> <p>Dead space (ml)</p> <p>Weight (g)</p> <p>Pressure drop kPa (cm H2O)</p> <p>- at 30 l/min</p> <p>- at 60 l/min</p>	<p>557021200</p> <p>M1003346</p> <p>557022500</p> <p>55702300*</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p> <p>-99,98</p> <p>>99,99999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>60</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>22</p> <p>0,4</p> <p>0,8</p> <p>0,7</p> <p>0,7</p> <p>0,14</p> <p>0,8</p> <p>0,22</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p> <p>0,2</p> <p>0,1</p> <p>0,8</p> <p>0,2</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p>
<p>*Mean values. Measured by Nelson Laboratories Inc., USA. Records on file. **See additional Information Sheet for Dead space.</p>	
<p>Technical data</p> <p>Filtration efficiency</p> <p>- Bacterial (%)</p> <p>- Viral (%)</p> <p>Dead space (ml)</p> <p>Weight (g)</p> <p>Pressure drop kPa (cm H2O)</p> <p>- at 30 l/min</p> <p>- at 60 l/min</p>	<p>557022500</p> <p>M1003346</p> <p>557023000</p> <p>55702300*</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p> <p>-99,98</p> <p>>99,99999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>60</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>22</p> <p>0,4</p> <p>0,8</p> <p>0,7</p> <p>0,7</p> <p>0,14</p> <p>0,8</p> <p>0,22</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p> <p>0,2</p> <p>0,1</p> <p>0,8</p> <p>0,2</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p>
<p>*Mean values. Measured by Nelson Laboratories Inc., USA. Records on file. **See additional Information Sheet for Dead space.</p>	
<p>Technical data</p> <p>Filtration efficiency</p> <p>- Bacterial (%)</p> <p>- Viral (%)</p> <p>Dead space (ml)</p> <p>Weight (g)</p> <p>Pressure drop kPa (cm H2O)</p> <p>- at 30 l/min</p> <p>- at 60 l/min</p>	<p>557023000</p> <p>M1003346</p> <p>557022500</p> <p>55702300*</p> <p>M1010541</p> <p>M1003345</p> <p>-99,98</p> <p>>99,99999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>99,999</p> <p>60</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>22</p> <p>0,4</p> <p>0,8</p> <p>0,7</p> <p>0,7</p> <p>0,14</p> <p>0,8</p> <p>0,22</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p> <p>0,2</p> <p>0,1</p> <p>0,8</p> <p>0,2</p> <p>0,19</p> <p>0,19</p> <p>0,32</p>
<p>*Mean values. Measured by Nelson Laboratories Inc., USA. Records on file. **See additional Information Sheet for Dead space.</p>	

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

Предназначение
Филтрите могат да бъдат използвани да осигурят филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. Филтрите са предназначени за употреба в болница, отделение за интензивна грижа, при анестезия, респираторна терапия, по време на транспортация и в реанимационни отделения за филтриране на частици, вируси и dust from CO2 absorbers. The Filter with sampling port can also be used for gas sampling. Filters are indicated for use by qualified medical personnel only.

Material
PP Polipropylene
Not made with natural rubber latex.

AirLife™
Филтри, за еднократна употреба

Filter, engangs med eller uden samplersort
Brugervejledning

Tilsligt anvendelse
Filtrene kan bruges til at reducere en eventuel krydsinfektion mellem patient og udstyr. Filtrene er beregnet til brug på hospitaler, intensivafdelinger, anestesi, transport og i reanimationsafdelinger. Filtrene er beregnet til filtrering af partikler inklusive bakterier, virus og støv fra CO2 absorbere. Filtret med samplersort kan også anvendes til gasmåling. Filtret med samplingsport kan også anvendes til gasmåling.

Material
PP Polipropylene
Ikke fremstillet med naturligt latexgummi.

Brugervejledning
Læs vejledningen omhyggeligt, før produktet tages i brug. Filtret skal tilsluttes åndedrætsrøret, enten mellem den proximale ende og / eller i tylen. Den inspiratoriske/ekspratoriske port i ventilatoren eller i anæstesi systemet. Det anbefales at skifte filtret efter max. 24 timers brug, eller tidligere hvis der er tegn på fugt indeni filtret.

Kontraindikationer
Filtrene skal ikke anvendes til patienter med kraftig sekretudledning i luftrøret og lunger. Filtret er ikke anvendes i ekspratorledelsen i sammenheng med en fugter, bar der installeres en vandfælde mellem filtret og patienten. Placer aldrig et filter i den inspiratoriske gren efter en fugter. Brug ikke filtret mellem patient og nebulizer når givnes medicin. Når nebulizer anvendes til medicin, skal maskinens i respiratoriskredsløbet monitoreres, og filteret skal udskiftes efter hospitalets gældende retningslinjer.

Forholdsregler
Før brug kontrolleres det, at alle slanger og koblinger til filtret er faste og tætte. Før brug skal verificeres at filtret ikke har nogen tilstopning og at luft vil strømme igennem det. Kompensering for det døde rum, der tilføres systemet, ved anvendelse af filtret, kan være nødvendig. Når brug af filtret med samplingsport eller forsløset luft til slanger for, at gasudladingsforholdene på filtret med gasudladingsport er omhyggeligt fastgjort.

Advarsler
Engangsiltarbejer er ikke beregnet til at blive genanvendt. Genanvendelse kan forårsage risiko for kryds-kontaminering, påvirke nøjagtigheden af målinger og/eller systemets ydeevne eller forårsage fejlfunktion som et resultat af et produkt er fysisk skadet som følge af rensning, desinficering, re-sterilisation og/eller brug.

Technical data
557021200 M1003346 557022500 M1010541 M1003345 55702300*
Filtrationseffektivitet
Bakterielle (%) -99,98 >99,99999 99,999 99,999 99,999 99,999
Virus (%) -99,9 99,999 99,999 99,999 99,999 99,98
Dødede rum (ml) 60 35 35 36 22
Vægt (g) 27 16 16 16 14
Trykspændingsfald kPa (cm H2O)

- at 30 l/min 0,4 0,8 0,07 0,07 0,14
- at 60 l/min 0,8 0,22 0,19 0,19 0,32

* Middel værdier. Målt efter til Nelsn Laboratories Inc., USA.
** Se yderligere oplysninger på vores hjemmeside.

Technical data
557021200 M1003346 557022500 M1010541 M1003345 55702300*
Filtrationseffektivitet
Bakterielle (%) -99,98 >99,99999 99,999 99,999 99,999 99,999
Virus (%) -99,9 99,999 99,999 99,999 99,999 99,98
Dødede rum (ml) 60 35 35 36 22
Vægt (g) 27 16 16 16 14
Trykspændingsfald kPa (cm H2O)

- at 30 l/min 0,4 0,8 0,07 0,07 0,14
- at 60 l/min 0,8 0,22 0,19 0,19 0,32

* Middel værdier. Målt efter til Nelson Laboratories Inc., USA.
** Se yderligere oplysninger på vores hjemmeside.

Technical data
557021200 M1003346 557022500 M1010541 M1003345 55702300*
Filtrationseffektivitet
Bakterielle (%) -99,98 >99,99999 99,999 99,999 99,999 99,999
Virus (%) -99,9 99,999 99,999 99,999 99,999 99,98
Dødede rum (ml) 60 35 35 36 22
Vægt (g) 27 16 16 16 14
Trykspændingsfald kPa (cm H2O)

- at 30 l/min 0,4 0,8 0,07 0,07 0,14
- at 60 l/min 0,8 0,22 0,19 0,19 0,32

* Middel værdier. Målt efter til Nelson Laboratories Inc., USA.
** Se yderligere oplysninger på vores hjemmeside.

 Polski
AirLife™
Filtr, jednorazowe z portem próbkowania i bez portu
Instrukcja stosowania

Przoznaczenie

Filtr jest przeznaczony do zatrzymywania możliwych wzajemnych zanieczyszczeń pomiędzy pacjentem a urządzeniem. Filtry mogą być używane na oddziałach intensywnej terapii, podczas zabiegów, transportu oraz podczas reanimacji. Filtry są przeznaczone do zatrzymywania bakterii, wirusów oraz pyłu pochodzącego z pochłaniania CO2. Filtr z portem próbkowania może być również stosowany do monitorowania gęstości i zawieszenia cząstek. Filtry są przeznaczone wyłącznie do stosowania przez wykwalifikowaną personel medyczny.

Material

PP Polipropylen

W procesie wytwarzania nie użyto naturalnej gury lateksowej.

a) Port próbkowania gazów

Instrukcja stosowania

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Peça em Y do circuito respiratório, o conectado às portas inspiratória/expiratória do ventilador o sistema de anestesia.
A frequência recomendada de substituição do filtro é após um máximo de 24 horas de uso ou mais cedo, caso haja evidências de umidade dentro do filtro.

Contraindicācijas
Os filtros são contraindicados para pacientes com secreção espumosa fatal nas vias aéreas ou pulmões.
Quando o filtro é usado em um membro expiratório em conjunto com um umidificador com água, um condensador de umidade deve ser posicionado entre o filtro e o água.

Instrukcja stosowania
Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Peça em Y do circuito respiratório, o conectado às portas inspiratória/expiratória do ventilador o sistema de anestesia.
A frequência recomendada de substituição do filtro é após um máximo de 24 horas de uso ou mais cedo, caso haja evidências de umidade dentro do filtro.

Contraindicācijas
Os filtros são contraindicados para pacientes com secreção espumosa fatal nas vias aéreas ou pulmões.
Quando o filtro é usado em um membro expiratório em conjunto com um umidificador com água, um condensador de umidade deve ser posicionado entre o filtro e o água.

Przeznaczenie
Stosowanie filtra jest przeznaczone u pacjentów, z których dróg oddechowych i płuc uwolniono wydobywa się pleńnia wydzielana.
Początek pracy filtr gwarantowany na gamieniu użytkownikom początkowym z laznią wodną.
Nie należy używać filtra z umiesszoną porcją filtracji i pacjencie.

Nigdy nie należy umieszczać filtra na ramieniu wdechowym ronejzy poziomu

Przed użyciem należy upewnić się, że filtr jest drożny i (bez bezwładne przepływu).
Stawając filtr konieczne może być odcięcie wprowadzenie przepływu w osamotnieniu wentylacji, związane z zwiększeniem objętości układu oddechowego o przesłonięciu filtra.

Jeśli przewidziano, że filtr należy podłączyć, należy sprawdzić, czy nastąpiła na ponie próbkowania jest umieszczona prawidłowo.
Początek użytkowania filtra pacjent powinien być ściśle monitorowany, a w wyniku powstania powłoki, należy zadzwonić do szpitala oddziału oddechowego.

Środki ostrożności

Przed użyciem należy zmontować i sprawdzić wszystkie elementy układu oddechowego ujemniejąc się, że wszystkie połączenia są szczelne.
Przed użyciem pacjenta, czy filtr jest drożny i (bez bezwładne przepływu).
Stawając filtr konieczne może być odcięcie wprowadzenie przepływu w osamotnieniu wentylacji, związane z zwiększeniem objętości układu oddechowego o przesłonięciu filtra.

Jeśli przewidziano, że filtr należy podłączyć, należy sprawdzić, czy nastąpiła na ponie próbkowania jest umieszczona prawidłowo.
Początek użytkowania filtra pacjent powinien być ściśle monitorowany, a w wyniku powstania powłoki, należy zadzwonić do szpitala oddziału oddechowego.

Advertências
Produtos de uso único não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Advertências
Produtos de uso único não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Dane techniczne					
Wysokość filtra					
- całkowita (%)	>=9,98	>=9,99999	>=9,999	>=9,9999	>=9,99
- wirusowa (%)	>=9,9	>=9,999	>=9,999	>=9,999	>=9,998
Prześwitłość materiału (%)	60	35	35	36	22
Waga (g)	27	16	16	16	14
Spadek ciśnienia kPa (cm H2O)					
- a 30 l/min	0,4	0,8	0,7	0,7	0,14
- a 60 l/min	0,4	0,8	0,7	0,7	0,14
- przy 30 l/min	0,4	0,8	0,7	0,7	0,14
- przy 60 l/min	0,8	2,2	1,9	1,9	0,32

*) Wartość średnia.
Zmierzono metodą opracowaną przez Nelson Laboratories Inc., USA.
Wyniki pomiarów wykonano w warunkach laboratoryjnych.

Dane dotyczące przesłonięć martwej znajdują się w dodatkowym arkuszu informacyjnym.

Dopuszczalny okres magazynowania: maksymalnie 3 lata.
Data ważności wyprodukowanego na opakowaniu.

Znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
©2018 Vyaire. Vyaire, logo Vyaire oraz AirLife są znakami towarowymi lub znakami towarowymi zarejestrowanymi w firmie Vyaire Medical, Inc. lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych.

PT					
AirLife™					
Filtros, descartáveis com e sem porta de amostra					
Instruções de utilização					

 Português
AirLife™
Filtros, descartáveis com e sem porta para amostra
Instruções de utilização

Finalidade a que se destina

Os filtros podem ser utilizados para a redução de possível contaminação cruzada entre o paciente e o equipamento.
Os filtros destinam-se a utilização no hospital, UCI, anestesia, terapia respiratória, durante o transporte e em resuscitadores para a filtragem de partículas, incluindo bacterias, vírus e p dos absorvedores de CO2. O filtro com orifício de amostragem também pode ser utilizado para amostragem de gases.

Os filtros devem ser utilizados exclusivamente por pessoal médico qualificado.

Material

PP Polipropileno

Não fabricado com látex de borracha natural.

a) Port de amostragem de gases

Instruções de utilização

Le estas instruções com atenção antes de utilizar o produto.
O filtro será colocado entre a extremidade proximal da via aérea artificial e a peça em Y do circuito respiratório, ou ligada à porta inspiratória/expiratória do ventilador o sistema de anestesia.

A frequência recomendada para a substituição do filtro é de 24 horas de utilização no máximo ou mais cedo no caso de humidade evidente no seu interior.

Contra-indicações
Encontra-se contraindicada a utilização de filtros em doentes que produzam grandes quantidades de secreções fulminantes nas vias respiratórias e nos pulmões.
Quando um filtro for utilizado no ramo expiratório juntamente com um humidificador de umidade, deve-se a colocar um condensador de humidade entre o filtro e o paciente.

Precauções
Todos os dispositivos aos filtros devem ser ligados e fixos correctamente e deve verificar-se a existência de fugas antes de qualquer utilização.
Certifique-se de que não há obstruções e que o fluxo de ar ocorre normalmente. Poderá ser necessário realizar uma compensação da ventilação quando se utilizar os filtros próximo do paciente, uma vez que a sua introdução no circuito corresponde à adição de espaço morto no sistema.

Se não estiver ligado, o uso do amostragem, certifique-se de que a Tampa do orifício de amostragem se encontra correctamente fixada no filtro com o uso de amostragem.

Durante o uso dos filtros, o doente deve ser vigiado cuidadosamente, sendo-ho administrados cuidados respiratórios adequados no caso de surtirum complicações.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

 Português (Brasil)
AirLife™
Filtros, descartáveis com e sem porta de amostragem
Instruções de uso

Filtros, descartáveis com e sem porta de amostragem

Instruções de uso

Uso pretendido
Os filtros devem ser usados para fornecer filtragem e reduzir a contaminação cruzada entre pacientes e equipamentos.
Os filtros devem ser utilizados em hospitais, UCI, anestesia, terapias respiratórias, transporte ou durante procedimentos de reanimação para partículas incluindo bacterias, vírus e poeira dos absorvedores de CO2. Os filtros com porta de amostragem também podem ser usados para amostras de gases.

Os filtros devem ser usados apenas por equipes médicas qualificadas.
Personal medycny.

Material

PP Polipropileno

Não fabricado com látex de borracha natural.

a) Porta de amostragem de gases

Instruções de uso

Le estas instruções com atenção antes de utilizar o produto.
Os filtros devem ser posicionados entre a extremidade proximal da via aérea artificial e a peça em Y do circuito respiratório, ou conectados às portas inspiratória/expiratória do ventilador o sistema de anestesia.

A frequência recomendada de substituição do filtro é após um máximo de 24 horas de uso ou mais cedo, caso haja evidências de umidade dentro do filtro.

Contraindicācijas
Os filtros são contraindicados para pacientes com secreção espumosa fatal nas vias aéreas ou pulmões.
Quando o filtro é usado em um membro expiratório em conjunto com um umidificador com água, um condensador de umidade deve ser posicionado entre o filtro e o água.

Instrukcja stosowania
Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Peça em Y do circuito respiratório, o conectado às portas inspiratória/expiratória do ventilador o sistema de anestesia.
A frequência recomendada de substituição do filtro é após um máximo de 24 horas de uso ou mais cedo, caso haja evidências de umidade dentro do filtro.

Contraindicācijas
Os filtros são contraindicados para pacientes com secreção espumosa fatal nas vias aéreas ou pulmões.
Quando o filtro é usado em um membro expiratório em conjunto com um umidificador com água, um condensador de umidade deve ser posicionado entre o filtro e o água.

Przeznaczenie
Stosowanie filtra jest przeznaczone u pacjentów, z których dróg oddechowych i płuc uwolniono wydobywa się pleńnia wydzielana.
Początek pracy filtr gwarantowany na gamieniu użytkownikom początkowym z laznią wodną.
Nie należy używać filtra z umiesszoną porcją filtracji i pacjencie.

Nigdy nie należy umieszczać filtra na ramieniu wdechowym ronejzy poziomu

Przed użyciem należy upewnić się, że filtr jest drożny i (bez bezwładne przepływu).
Stawając filtr konieczne może być odcięcie wprowadzenie przepływu w osamotnieniu wentylacji, związane z zwiększeniem objętości układu oddechowego o przesłonięciu filtra.

Jeśli przewidziano, że filtr należy podłączyć, należy sprawdzić, czy nastąpiła na ponie próbkowania jest umieszczona prawidłowo.
Początek użytkowania filtra pacjent powinien być ściśle monitorowany, a w wyniku powstania powłoki, należy zadzwonić do szpitala oddziału oddechowego.

Środki ostrożności
Przed użyciem należy zmontować i sprawdzić wszystkie elementy układu oddechowego ujemniejąc się, że wszystkie połączenia są szczelne.
Przed użyciem pacjenta, czy filtr jest drożny i (bez bezwładne przepływu).
Stawając filtr konieczne może być odcięcie wprowadzenie przepływu w osamotnieniu wentylacji, związane z zwiększeniem objętości układu oddechowego o przesłonięciu filtra.

Jeśli przewidziano, że filtr należy podłączyć, należy sprawdzić, czy nastąpiła na ponie próbkowania jest umieszczona prawidłowo.
Początek użytkowania filtra pacjent powinien być ściśle monitorowany, a w wyniku powstania powłoki, należy zadzwonić do szpitala oddziału oddechowego.

Advertências
Produtos de uso único não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Advertências
Produtos de uso único não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Advertências
Produtos de uso único não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Dane techniczne					
Wysokość filtra					
- całkowita (%)	>=9,98	>=9,99999	>=9,999	>=9,9999	>=9,99
- wirusowa (%)	>=9,9	>=9,999	>=9,999	>=9,999	>=9,998
Prześwitłość materiału (%)	60	35	35	36	22
Waga (g)	27	16	16	16	14
Spadek ciśnienia kPa (cm H2O)					
- a 30 l/min	0,4	0,8	0,7	0,7	0,14
- a 60 l/min	0,4	0,8	0,7	0,7	0,14
- przy 30 l/min	0,4	0,8	0,7	0,7	0,14
- przy 60 l/min	0,8	2,2	1,9	1,9	0,32

*) Wartość średnia.
Zmierzono metodą opracowaną przez Nelson Laboratories Inc., USA.
Wyniki pomiarów wykonano w warunkach laboratoryjnych.

Dane dotyczące przesłonięć martwej znajdują się w dodatkowym arkuszu informacyjnym.

Dopuszczalny okres magazynowania: maksymalnie 3 lata.
Data ważności wyprodukowanego na opakowaniu.

Znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
©2018 Vyaire. Vyaire, logo Vyaire oraz AirLife są znakami towarowymi lub znakami towarowymi zarejestrowanymi w firmie Vyaire Medical, Inc. lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych.

PT					
AirLife™					
Filtros, descartáveis com e sem porta para amostra					
Instruções de utilização					

 Português
AirLife™
Filtros, descartáveis com e sem porta para amostra
Instruções de utilização

 Português
AirLife™
Filtros, descartáveis com e sem porta para amostra
Instruções de utilização

 Português
AirLife™
Filtros, descartáveis com e sem porta para amostra
Instruções de utilização

 Português
AirLife™
Filtros, descartáveis com e sem porta para amostra
Instruções de utilização

Finalidade a que se destina
Os filtros podem ser utilizados para a redução de possível contaminação cruzada entre o paciente e o equipamento.
Os filtros destinam-se a utilização no hospital, UCI, anestesia, terapia respiratória, durante o transporte e em resuscitadores para a filtragem de partículas, incluindo bacterias, vírus e p dos absorvedores de CO2. O filtro com orifício de amostragem também pode ser utilizado para amostragem de gases.

Os filtros devem ser utilizados exclusivamente por pessoal médico qualificado.

Material

PP Polipropileno

Não fabricado com látex de borracha natural.

a) Port de amostragem de gases

Instruções de utilização

Le estas instruções com atenção antes de utilizar o produto.
O filtro será colocado entre a extremidade proximal da via aérea artificial e a peça em Y do circuito respiratório, ou ligada à porta inspiratória/expiratória do ventilador o sistema de anestesia.

A frequência recomendada para a substituição do filtro é de 24 horas de utilização no máximo ou mais cedo no caso de humidade evidente no seu interior.

Contra-indicações
Encontra-se contraindicada a utilização de filtros em doentes que produzam grandes quantidades de secreções fulminantes nas vias respiratórias e nos pulmões.
Quando um filtro for utilizado no ramo expiratório juntamente com um humidificador de umidade, deve-se a colocar um condensador de humidade entre o filtro e o paciente.

Precauções
Todos os dispositivos aos filtros devem ser ligados e fixos correctamente e deve verificar-se a existência de fugas antes de qualquer utilização.
Certifique-se de que não há obstruções e que o fluxo de ar ocorre normalmente. Poderá ser necessário realizar uma compensação da ventilação quando se utilizar os filtros próximo do paciente, uma vez que a sua introdução no circuito corresponde à adição de espaço morto no sistema.

Se não estiver ligado, o uso de amostragem, certifique-se de que a Tampa do orifício de amostragem se encontra correctamente fixada no filtro com o uso de amostragem.

Durante o uso dos filtros, o doente deve ser vigiado cuidadosamente, sendo-ho administrados cuidados respiratórios adequados no caso de surtirum complicações.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Advertências
Os produtos para utilização única não devem ser reutilizados.
A reutilização poderá causar um risco de contaminação cruzada, afetar a precisão da medição e/ou o desempenho do sistema.
Consulte a ficha de informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie.
Ponowne użycie może być przyczyną zakłóceń krzyżowych, wpłynąc na dokładność pomiarów lub wydajność systemu albo przyczyną nieprawidłowego działania wywołanego z uszkodzenia podczas szczytowania, dezynfekcji, rojownej sterylizacji i/lub ponownego użycia.

Advertências



FINAL REPORT

EVALUATION OF ANTIMICROBIAL FINISHES

PROCEDURE NO. STP0156 REV 01
PROTOCOL DETAIL SHEET NO. 200903475 REV 01

LABORATORY NO. 503764

PREPARED FOR:

ALEJANDRO MANUNTA
ACCUMED TECHNOLOGIES
160 BUD-MIL DR.
BUFFALO NY 14206

SUBMITTED BY:

NELSON LABORATORIES, INC.
6280 S. REDWOOD RD.
SALT LAKE CITY UT 84123-6600
801-290-7500

Page 1 of 9



NELSON LABORATORIES, INC.

QAU AUDIT STATEMENT

USFDA (21 CFR PART 58)

USEPA (40 CFR PART 160)

EVALUATION OF ANTIMICROBIAL FINISHES


LABORATORY NO. 503764

1. The test was conducted in accordance with the USFDA or USEPA Regulations as noted above.
2. In accordance with the Good Laboratory Practice Regulations, the Inoculation phase(s) of this study was inspected by the Quality Assurance Unit on: 01 Dec 2009. The findings of the inspection(s) were reported to the Study Director and to Management on: 10 Dec 2009.
3. The Quality Assurance Unit has reviewed this report and has determined that the methods and standard testing procedures are accurately described, and that the reported results accurately reflect the raw data.
4. The name of the study director, the names of other scientists or professionals, and the names of all supervisory personnel, involved in the study:

Mike Neilson
Nina Patterson

Dr. Jerry Nelson
Jeff Hills

QUALITY ASSURANCE:



DATE: 11 Dec 2009

EVALUATION OF ANTIMICROBIAL FINISHES

LABORATORY NUMBER:	503764
PROCEDURE NUMBER:	STP0156 REV 01
PROTOCOL DETAIL SHEET NUMBER:	200903475 REV 01
SAMPLE SOURCE:	AccuMed Technologies
SAMPLE IDENTIFICATION:	Refer to Tables 1-5
DEVIATIONS:	None
PROTOCOL APPROVAL DATE:	25 Nov 2009
SAMPLE RECEIVED DATE:	25 Nov 2009
LAB PHASE START DATE:	25 Nov 2009
LAB PHASE COMPLETION DATE:	08 Dec 2009
REPORT ISSUE DATE:	10 Dec 2009

INTRODUCTION:

This report details the methods used for assessing antimicrobial finishes. The challenge procedure consisted of inoculating uniform pieces of the test material with the test organism(s), then determining the percent reduction of the test organism(s) after specified exposure periods.

ACCEPTANCE CRITERIA:

All positive and negative controls must be positive or negative for growth of the test organism(s), respectively. Neutralization must be confirmed at $\geq 70\%$.

PROCEDURE:

The test samples were cut by Nelson Laboratory personnel in approximately 25 mm x 50 mm test pieces. The "test sample" for this study was determined to consist of one piece of material. All tests were performed in duplicate, including triplicate plate counts.

The organisms were transferred to soybean casein digest broth (SCDB) and incubated at $37 \pm 2^\circ\text{C}$ for 18-24 hours. The culture was vortexed to remove clumps and the concentration was adjusted to the appropriate challenge level using visual turbidity. A 1.0 mL aliquot of the adjusted organism suspension was added to 100 mL of agar slurry (SASL) which was tempered at $45 \pm 2^\circ\text{C}$.

A 1.0 mL aliquot of the inoculated SASL was added to each test sample and positive control. The inoculum was applied slowly and gently with a low angle of incidence relative to the sample in order to form a film of no more than 1 mm in depth. The test samples were held in closed containers at $37 \pm 2^\circ\text{C}$ for the designated time intervals. At time 24, 48 and 72 hours the samples were extracted by removing the sample from the containers and placing them into 100 mL bottles of Lethen broth (LETH). The bottles were shaken manually for one minute or 100 times in a 12 inch path to extract surviving organism. Extracts were serially diluted in LETH. Plate counts were performed in triplicate by plating 0.5 mL aliquots onto soybean casein digest agar (SCDA). This was repeated for each test organism and submitted sample type.

A positive control was performed by testing untreated material in the same manner as the test sample. A negative control was tested by plating 0.5 mL aliquots from a sterile 100 mL bottle of LETH onto the appropriate media in triplicate.

A neutralization qualification was performed for the treated materials to demonstrate that the neutralization and recovery methods were effective. The uninoculated neutralization sample was extracted in 100 mL of LETH and the challenge organism was added to yield ≤ 100 colony forming units (CFU)/mL. An additional bottle of 100 mL of LETH was inoculated with same challenge organism to serve as a control. Test extract fluid from all neutralization bottles was plated in triplicate onto SCDA using a standard spread plate method.

All plates were incubated at $37 \pm 2^\circ\text{C}$ for 2-4 days. Colonies were counted, and the data tabulated to facilitate comparisons.

CALCULATIONS:

Bacterial counts represent the number of bacteria per specimen sample (swatches in a container) not as the number of bacteria/mL of neutralizer solution.

Plate counts were entered into a validated spreadsheet where possible.

The log reduction values were calculated using the following formula:

$$\text{log reduction} = \log C - \log S$$

Where C = Average number of organisms recovered from the untreated control at 0 hour
Where S = Average number of organisms recovered from the treated test sample after exposure for the desired contact period

The percent reduction values were calculated using the following formula:

$$\% \text{ reduction} = \frac{100 (C-S)}{C}$$

The percent neutralization is obtained according to the following equation:

$$\% \text{ Neutralization} = \frac{\text{Average Sample Counts/Plate}}{\text{Average Control Counts/Plate}}$$

RESULTS:

The counts of recovered organisms, percent reductions and \log_{10} reductions for the test materials can be found in Tables 1-4. Values are considered approximate (~) when plate counts were outside of the statistically accurate range of 25-250 colony forming units (CFU)/plate for bacteria and yeast and 8-80 CFU/plate for mold. Less than symbols (<) are applied to recovery values where no CFU were observed on the plates. This denotes the limit of detection for the test.

Neutralization results are summarized in Table 5 with all treated samples demonstrating $\geq 70\%$ recovery.

Testing met the acceptance criteria previously stated in this report.

CONCLUSION:

Interpretation of the data is the responsibility of the sponsor and no conclusion can be made by Nelson Laboratories, Inc. (NLI).

DATA DISPOSITION:


The raw data and final report from this study are archived at NLI or an approved off-site location.

STATEMENT OF UNCERTAINTY

If applicable, a statement of uncertainty is available to sponsors upon request.



Nina Patterson, B.S.
Study Director



Study Completion Date

cw

TABLE 1. Results
Klebsiella pneumoniae, ATCC #4352
Average Control Titer at Time Zero (CFU/Sample): 3.5×10^6

SAMPLE IDENTIFICATION	EXPOSURE INTERVALS	PERCENT REDUCTION (%)	LOG ₁₀ REDUCTION
B-25-0190	24 Hour	>99.9944	>4.25
	48 Hour	>99.9944	>4.25
	72 Hour	>99.9944	>4.25
B-25-0104 (Positive Control)	24 Hour	~-2105.1	~-1.34
	48 Hour	~-1318.6	~-1.15
	72 Hour	-876	-0.99

TABLE 2. Results
Escherichia coli, ATCC #8739
Average Control Titer at Time Zero (CFU/Sample): 2.9×10^6

SAMPLE IDENTIFICATION	EXPOSURE INTERVALS	PERCENT REDUCTION (%)	LOG ₁₀ REDUCTION
B-25-0190	24 Hour	>99.9931	>4.16
	48 Hour	>99.9931	>4.16
	72 Hour	>99.9931	>4.16
B-25-0104 (Positive Control)	24 Hour	~-1384.6	~-1.17
	48 Hour	-1041.7	-1.06
	72 Hour	-1404.0	-1.18

TABLE 3. Results
Staphylococcus aureus, ATCC #6538
Average Control Titer at Time Zero (CFU/Sample): 3.7×10^6

SAMPLE IDENTIFICATION	EXPOSURE INTERVALS	PERCENT REDUCTION (%)	LOG ₁₀ REDUCTION
B-25-0190	24 Hour	>99.9946	>4.27
	48 Hour	>99.9946	>4.27
	72 Hour	>99.9946	>4.27
B-25-0104 (Positive Control)	24 Hour	-54	-0.19
	48 Hour	30	0.15
	72 Hour	67	0.48

TABLE 4. Results
Pseudomonas aeruginosa, ATCC #9027
Average Control Titer at Time Zero (CFU/Sample): 3.5×10^6

SAMPLE IDENTIFICATION	EXPOSURE INTERVALS	PERCENT REDUCTION (%)	LOG ₁₀ REDUCTION
B-25-0190	24 Hour	>99.9943	>4.24
	48 Hour	~99.966	~3.46
	72 Hour	~99.981	~3.72
B-25-0104 (Positive Control)	24 Hour	~-2571.1	~-1.43
	48 Hour	~-2165.0	~-1.36
	72 Hour	~-1710.3	~-1.26

TABLE 5. Neutralization

SAMPLE IDENTIFICATION	ORGANISM	PERCENT NEUTRALIZATION (%)
B-25-0190	<i>K. pneumoniae</i>	115
	<i>E. coli</i>	121
	<i>S. aureus</i>	97
	<i>P. aeruginosa</i>	88



AccuMed Technologies
Lab Number 503764

Evaluation of Antimicrobial Finishes

All reports and letters issued by Nelson Laboratories, Inc. are for the exclusive use of the sponsor to whom they are addressed. These results relate only to the samples tested. Reports may not be reproduced except in their entirety. No quotations from reports or use of the corporate name is permitted except as expressly authorized by Nelson Laboratories, Inc. in writing. The significance of any data is subject to the adequacy and representative character of the samples tendered for testing. Nelson Laboratories, Inc. warrants that all tests are performed in accordance with established laboratory procedures and standards. Nelson Laboratories, Inc. makes no other warranties of any kind, express or implied. Nelson Laboratories, Inc. expressly states that it makes no representation or warranty regarding the adequacy of the samples tendered for testing for any specific use of application, that determination being the sole responsibility of the sponsor. Nelson Laboratories' liability for any loss or damage resulting from its actions or failure to act shall not exceed the cost of tests performed, and it shall not be liable for any incidental or consequential damages. Nelson Laboratories, Inc. has a ten year record retention policy.

Lab Number: 503764

	FORM TITLE: PDS Approval Form	PDS NUMBER: 200903475
		PDS REVISION: 1

PREPARED FOR SPONSOR		LABORATORY / CONTRACTOR
CONTACT:	Alejandro Manunta	Nelson Laboratories, Inc. P.O. Box 17577 SALT LAKE CITY, UT. 84117-0557 6280 SOUTH REDWOOD ROAD SALT LAKE CITY, UT. 84123-6600 Tel: 801-290-7500 Fax: 801-290-7998 Web Site: www.nelsonlabs.com
COMPANY:	AccuMED Technologies	
EMAIL:	amanunta@accumedtech.com	
PHONE:	N/A	
FAX:	N/A	

PROTOCOL SPECIFICATIONS			
PARENTAL DOCUMENT:	Evaluation of Antimicrobial Finishes, STP0156, 1		
SECTION:	Pharmaceuticals		
PDS INITIATION DATE:	23-Nov-2009	EXPIRATION DATE:	23-Nov-2011

JUSTIFICATION:
Follow STP except for the steps listed in the protocol specifications.

PROTOCOL SPECIFICATIONS:
Refer to attached pages for protocol specifications.

Additional pages attached for protocol specifications
 No additional pages needed

The sponsor is responsible for test/control article characterization.
This includes, but is not limited to, identity, strength, purity, and stability.

****PLEASE SIGN, DATE, & RETURN TO NELSON LABORATORIES****

SPONSOR APPROVAL: *SIGNATURE: <u><i>Alejandro Manunta</i></u> DATE: <u>11/24/09</u> PRINT NAME: <u>Alejandro Manunta</u>	NELSON LABS STUDY DIRECTOR APPROVAL: SIGNATURE: <u><i>Nina Patterson</i></u> DATE: <u>25 Nov 2009</u> PRINT NAME: <u>Nina Patterson</u>
--	---

*SIGNING THIS DOCUMENT SIGNIFIES AN ACCEPTANCE OF THE NELSON LABORATORIES TESTING TERMS AND CONDITIONS AS ATTACHED OR AS LISTED AT WWW.NELSONLABS.COM/PROTOCOLCONDITIONS.JSP

FOR OFFICE USE ONLY	
LAB NUMBER: 503764	<input checked="" type="checkbox"/> FDA GLP <input type="checkbox"/> NON-GLP
SAMPLE ID:	See sample submission form

©2008 by Nelson Laboratories, Inc. All rights reserved. No part of this document shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without written permission from Nelson Laboratories Inc.

OFFICIAL